Pile Dynamics Inc
Transducer 294W

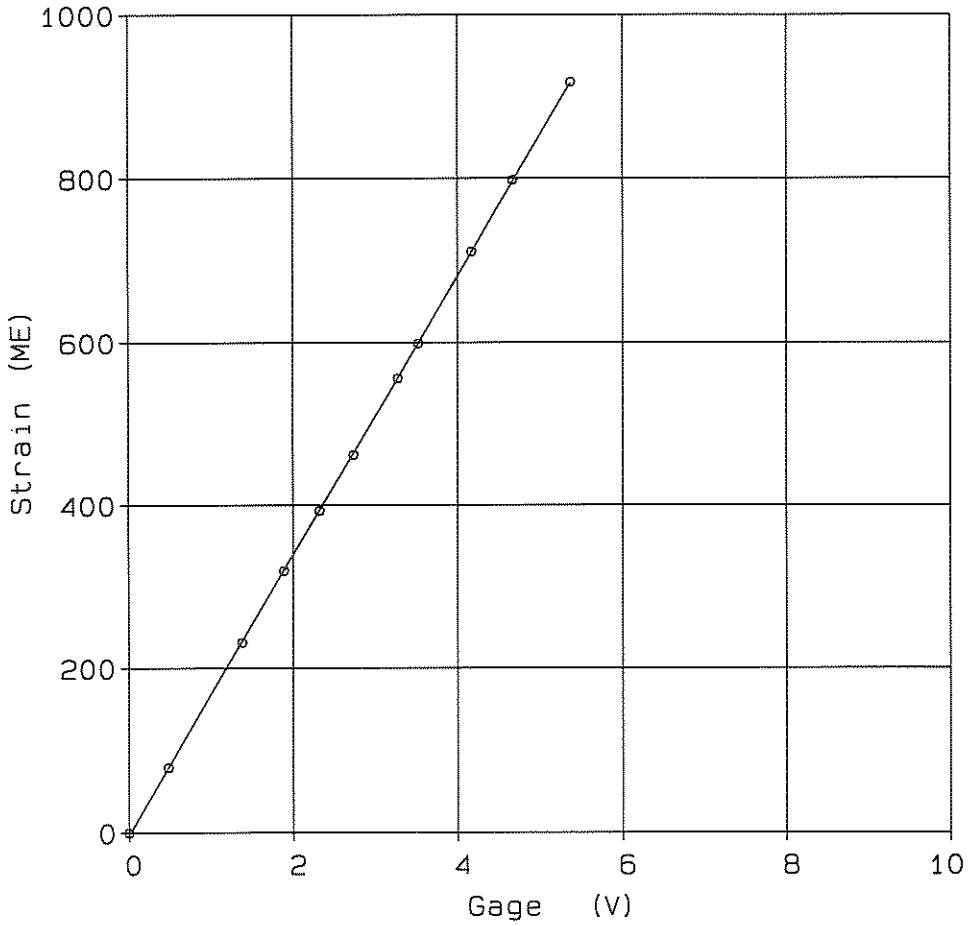

PDA Cal Factor = 171.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 594.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
80	.49
231	1.38
319	1.89
394	2.33
462	2.73
556	3.28
599	3.52
712	4.17
798	4.68
917	5.37

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 06-Mar-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2