Pile Dynamics Inc
Transducer 296I

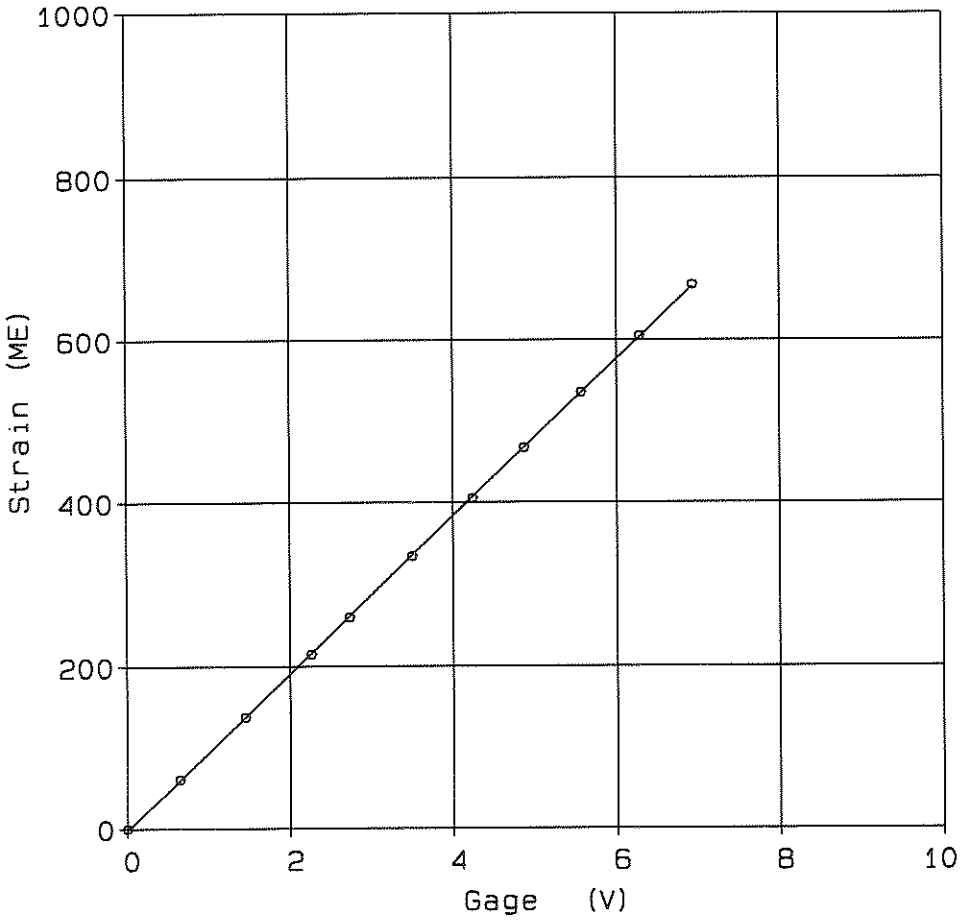

PDA Cal Factor = 96.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 335.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
62	.66
139	1.46
216	2.27
261	2.74
335	3.50
406	4.24
467	4.87
535	5.57
605	6.28
669	6.93

Calibrated by: James M Bell

Calibrated on: 19-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2