Pile Dynamics Inc

Transducer 296W

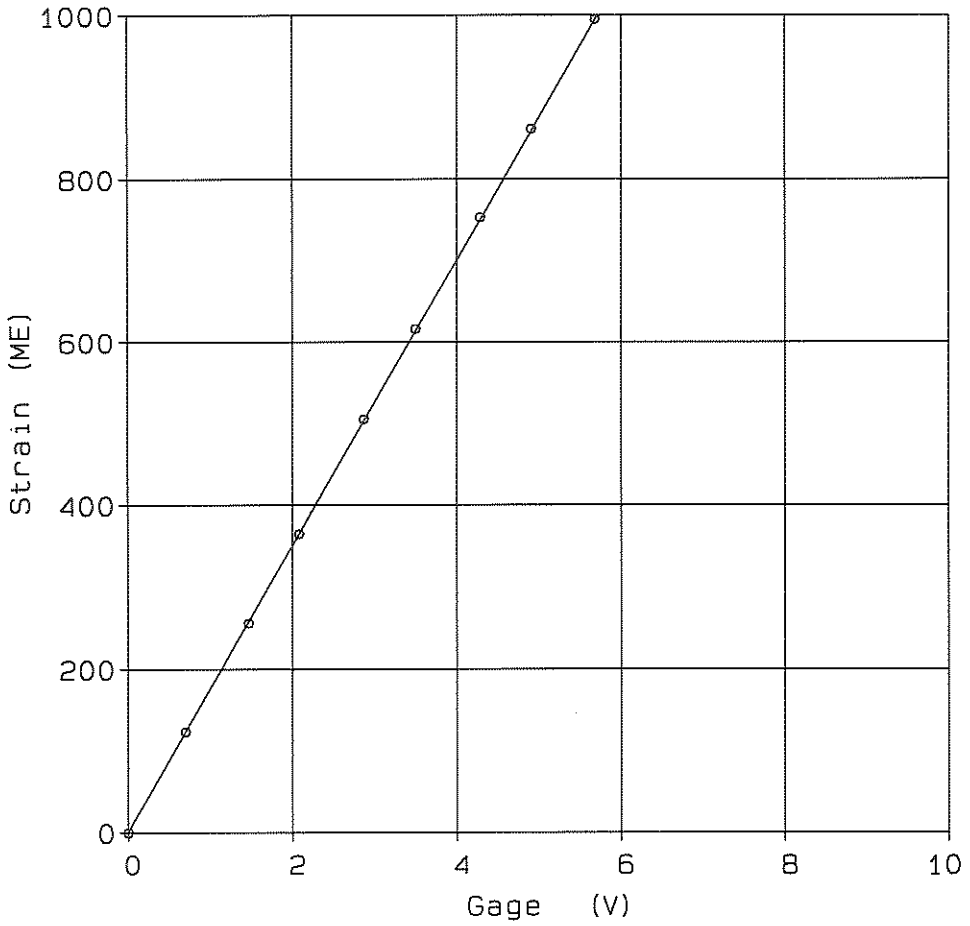

PDA Cal Factor = 174.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 606.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
123	.71
257	1.47
366	2.09
505	2.88
616	3.51
754	4.29
861	4.91
996	5.68
1100	6.29
1233	7.09

Calibrated by: J. Rausch

Calibrated on: 06-Mar-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2