Pile Dynamics Inc
Transducer 297I

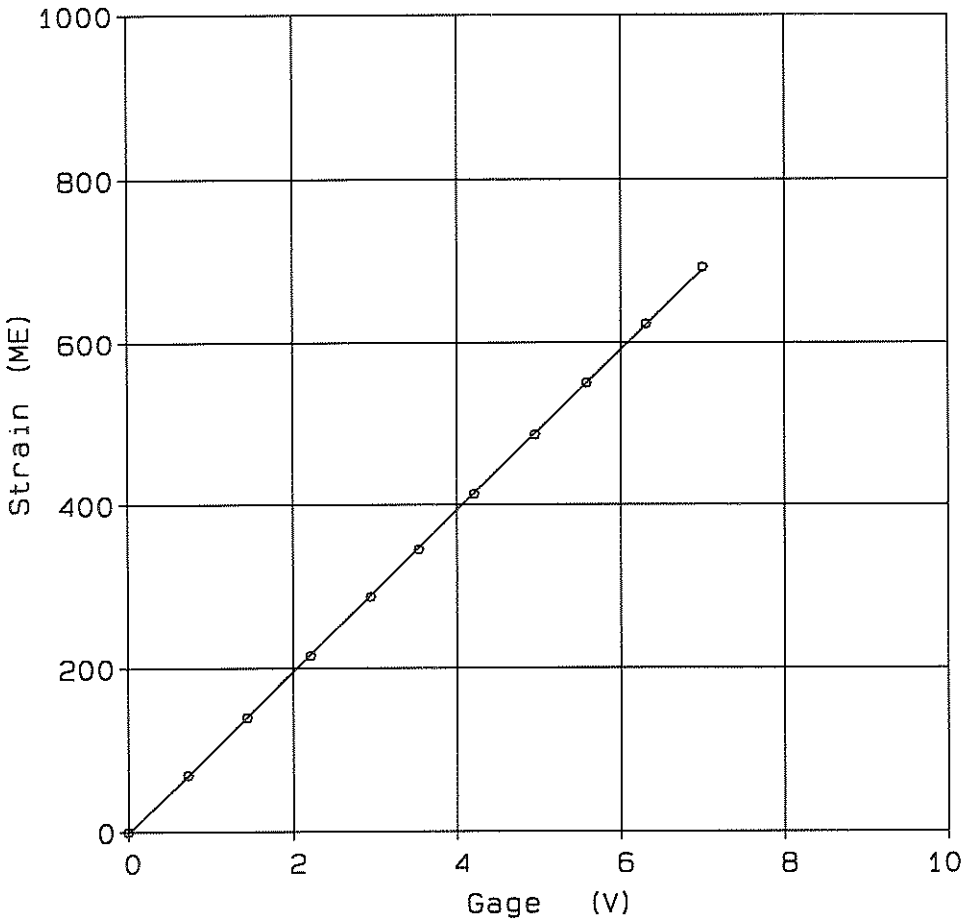

PDA Cal Factor = 99.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 343.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
70	.72
140	1.45
216	2.22
288	2.95
346	3.53
414	4.22
487	4.95
550	5.59
623	6.31
693	7.00

Calibrated by: _____

Calibrated on: 19-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2