Pile Dynamics Inc

Transducer 297W

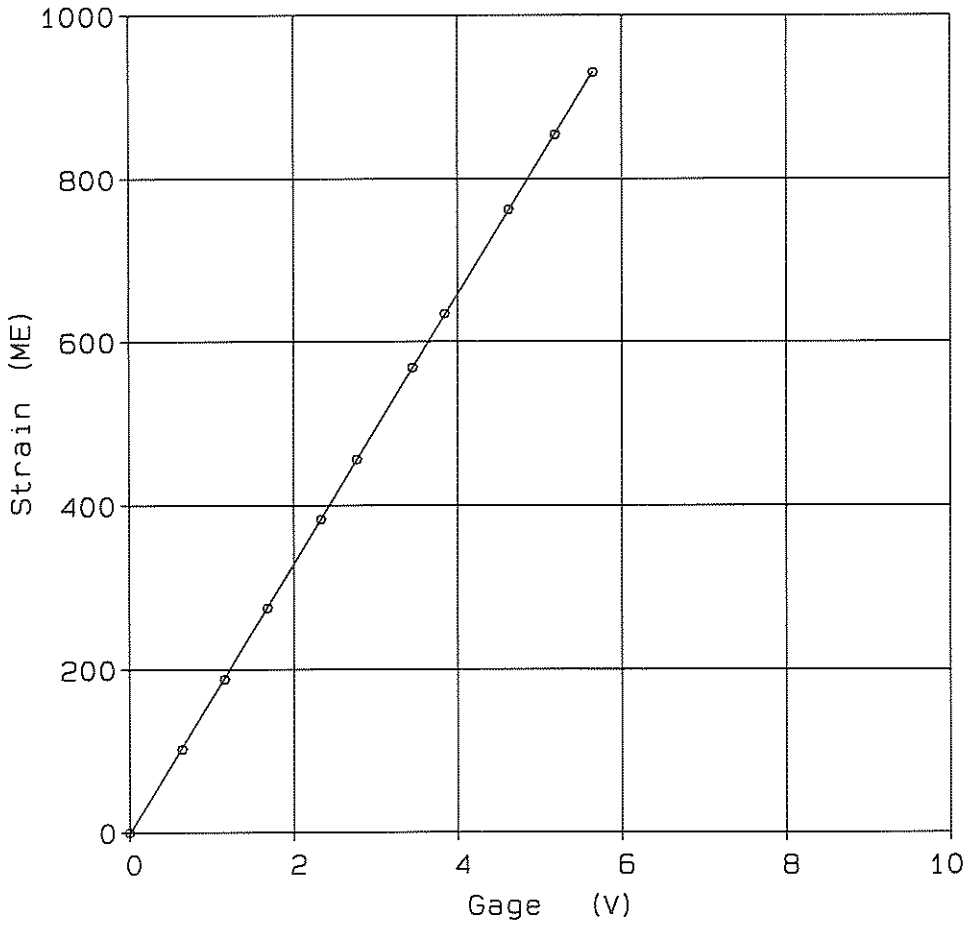

PDA Cal Factor = 165.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 573.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
103	.64
189	1.16
275	1.69
383	2.34
457	2.78
569	3.46
634	3.85
763	4.63
855	5.20
931	5.66

Calibrated by: J. Rausch

Calibrated on: 06-Mar-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2