Pile Dynamics Inc
Transducer 298I

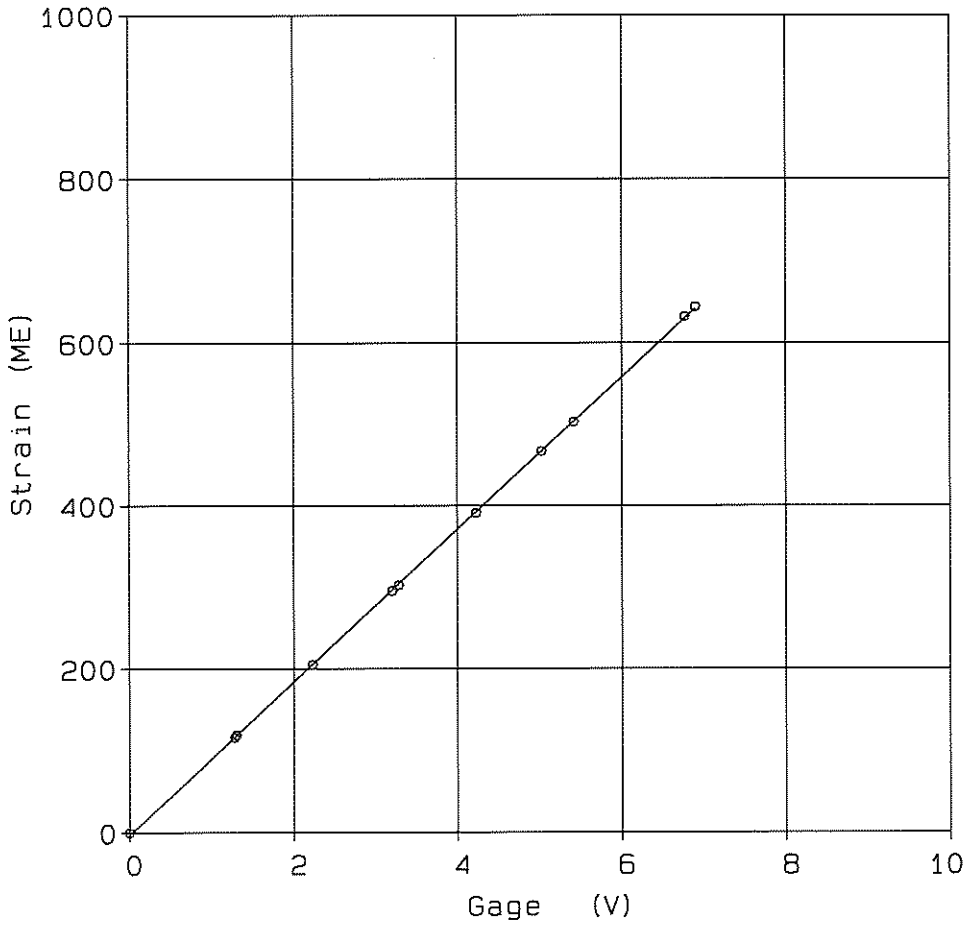

PDA Cal Factor = 93.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 324.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
120	1.31
116	1.28
205	2.24
296	3.21
302	3.28
392	4.24
467	5.03
504	5.42
633	6.77
644	6.90

Calibrated by: J. Rutledge

Calibrated on: 09-Jun-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2