Pile Dynamics Inc

Transducer 298W

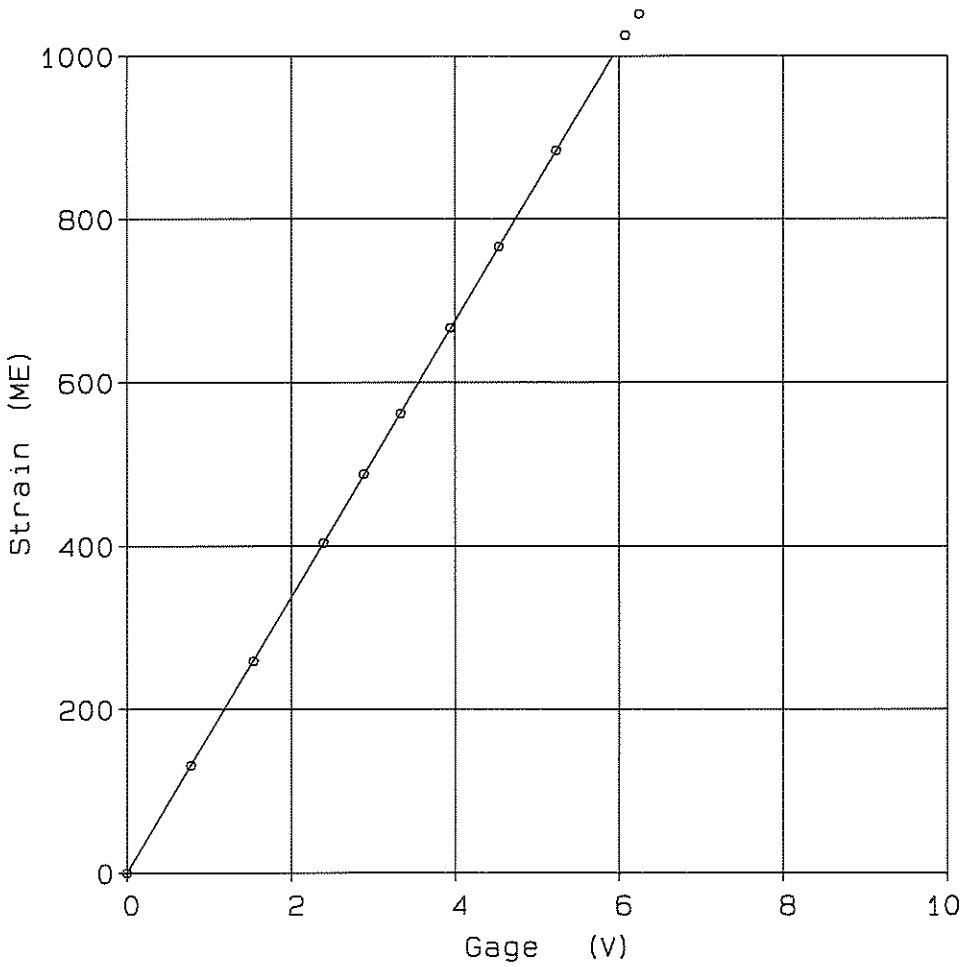

PDA Cal Factor = 168.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 586.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
132	.79
260	1.55
404	2.39
489	2.89
563	3.33
667	3.95
766	4.53
885	5.23
1025	6.08
1051	6.24

Calibrated by: J. Davidoff

Calibrated on: 07-Mar-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2