Pile Dynamics Inc
Transducer 299I

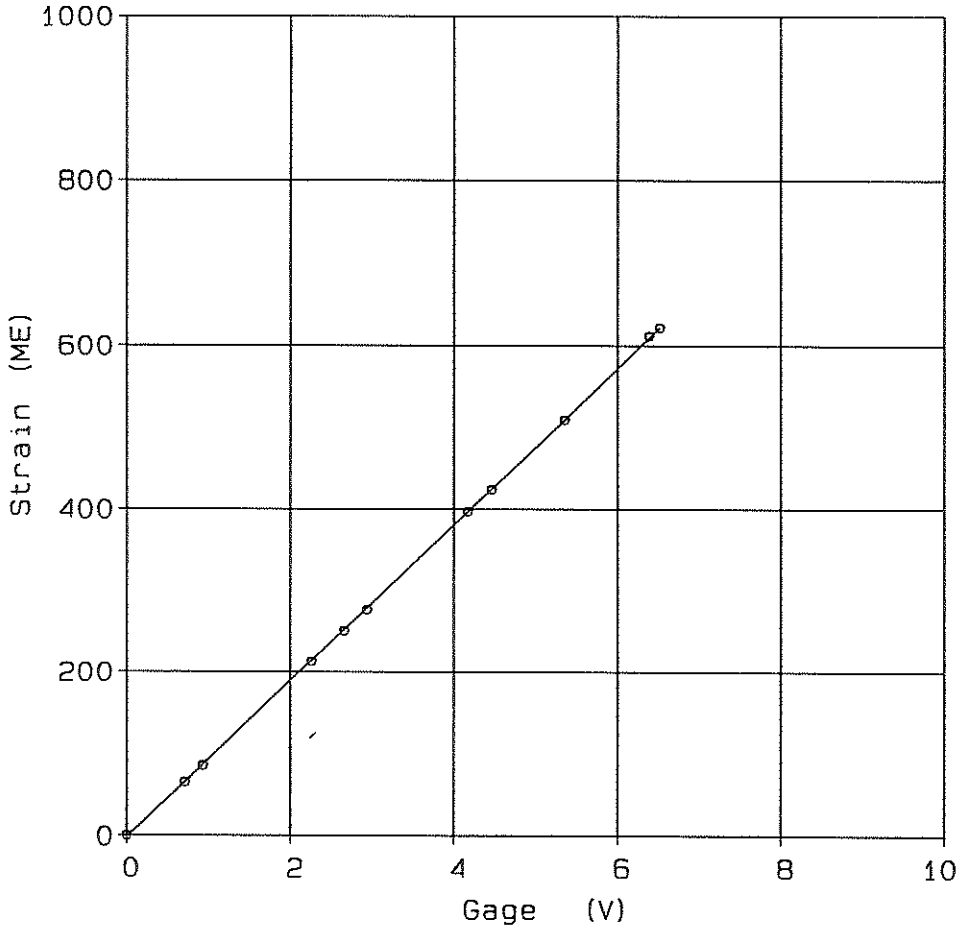

PDA Cal Factor = 95.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 332.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
66	.71
86	.94
213	2.26
252	2.66
277	2.95
397	4.17
425	4.47
510	5.36
613	6.39
623	6.52

Calibrated by: J. Deatsch

Calibrated on: 11-Jun-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2