
Pile Dynamics, Inc.

Transducer 300W

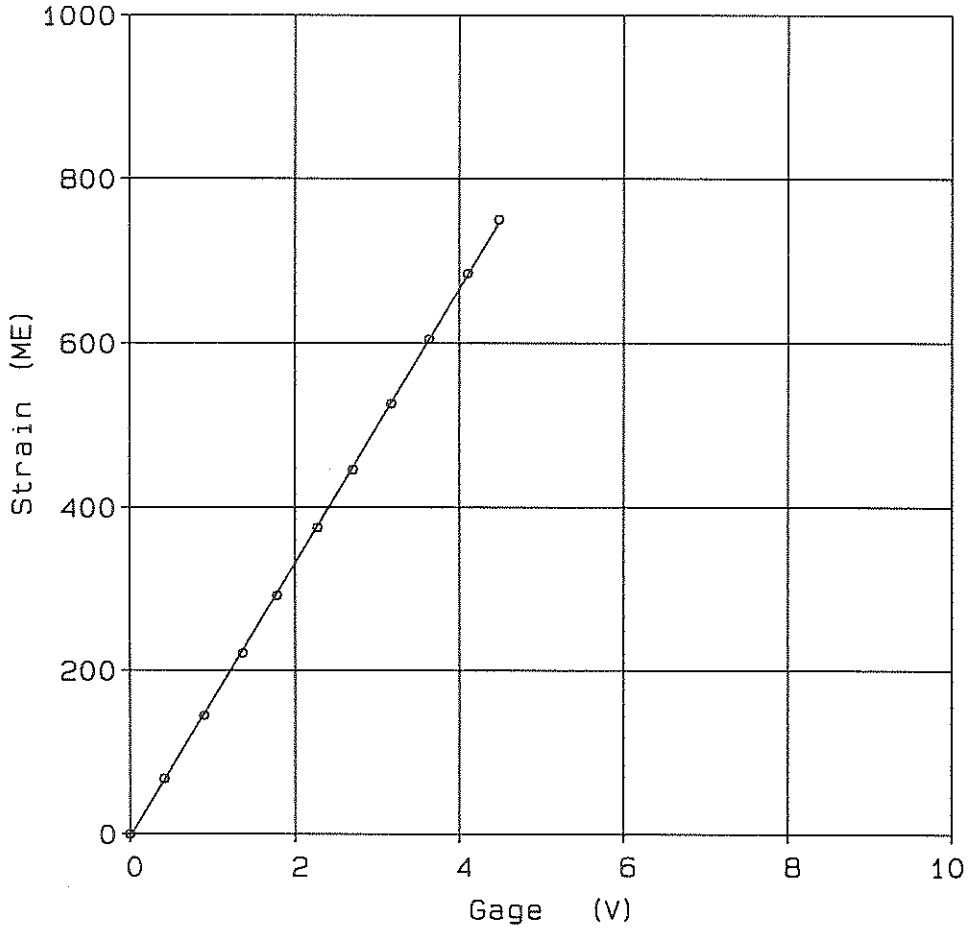

PDA Cal Factor = 167.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 582.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
68	.42
144	.89
222	1.36
293	1.78
375	2.28
447	2.70
526	3.18
605	3.63
686	4.10
751	4.49

Calibrated by: J.E. Rutledge

Calibrated on: 20-Apr-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2