
Pile Dynamics Inc
Transducer 303W

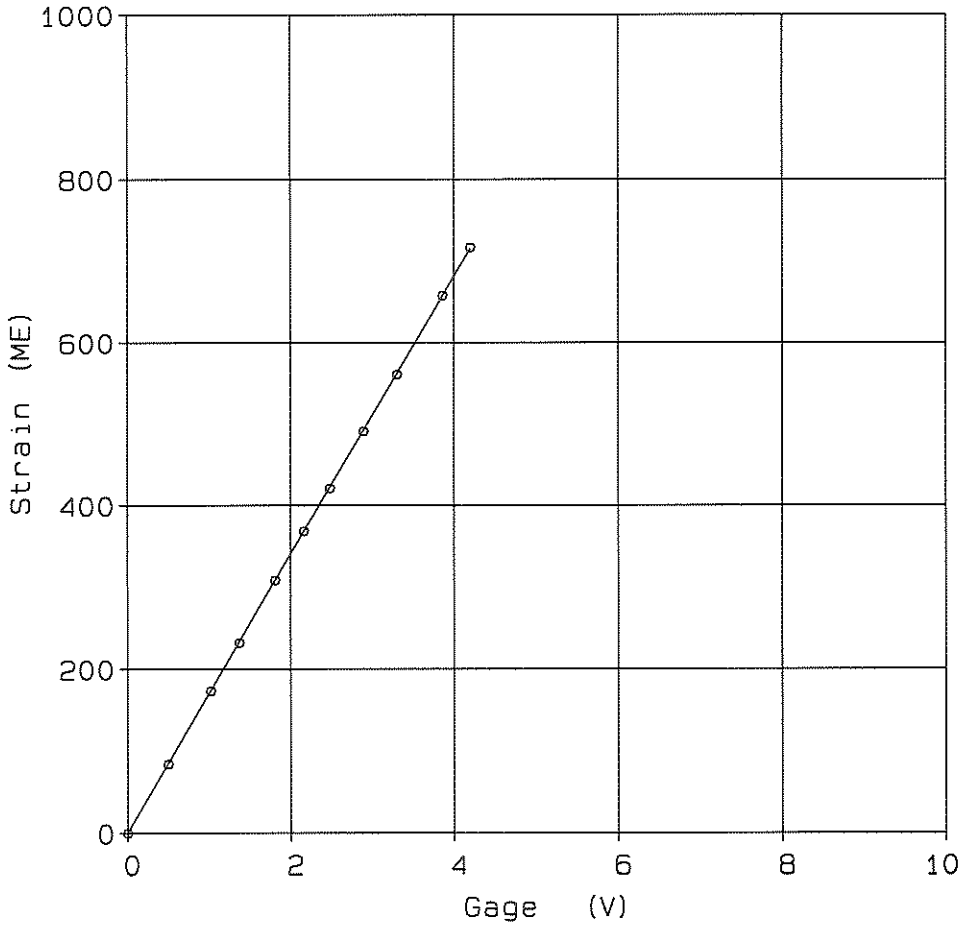

PDA Cal Factor = 170.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 592.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
85	.50
174	1.03
233	1.38
308	1.82
368	2.17
421	2.48
492	2.89
562	3.30
659	3.86
718	4.21

Calibrated by: J. Rausche

Calibrated on: 06-Mar-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2