
Pile Dynamics Inc
Transducer 306W

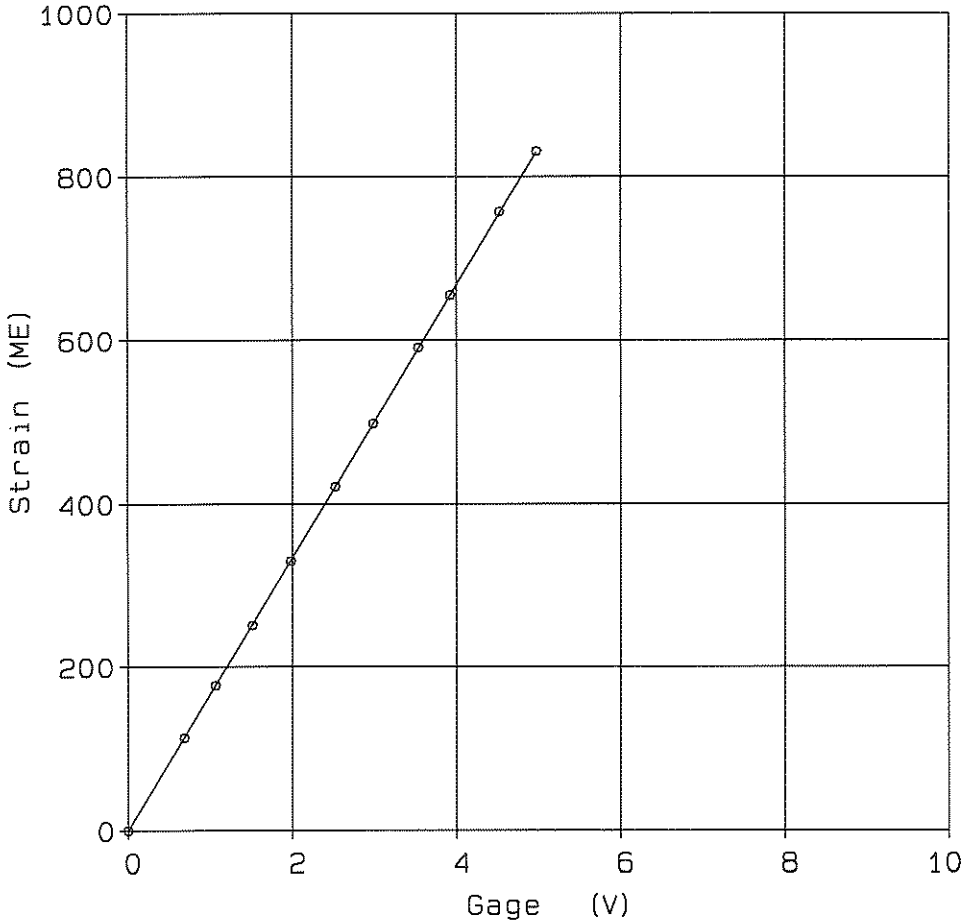

PDA Cal Factor = 167.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 580.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
114	.69
177	1.07
252	1.51
330	1.98
421	2.53
498	2.99
591	3.54
655	3.93
757	4.53
831	4.97

Calibrated by: J. Davidoff

Calibrated on: 06-Mar-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2