
# Pile Dynamics, Inc.
# Transducer 307W

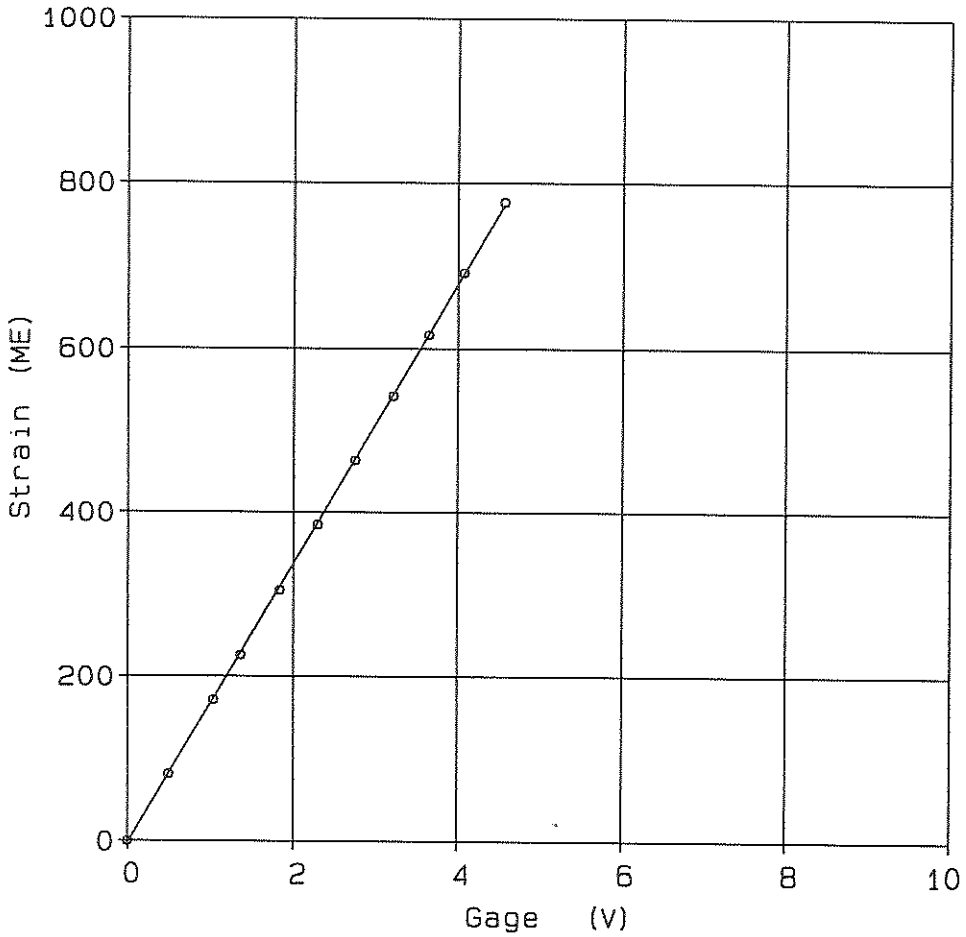


PDA Cal Factor = 170.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 593.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 80 | .49 |
| 172 | 1.04 |
| 227 | 1.36 |
| 306 | 1.83 |
| 386 | 2.29 |
| 464 | 2.75 |
| 543 | 3.21 |
| 618 | 3.64 |
| 693 | 4.07 |
| 777 | 4.56 |

Calibrated by: J. Dunbeloff

Calibrated on: 20-Apr-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2