
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 308W

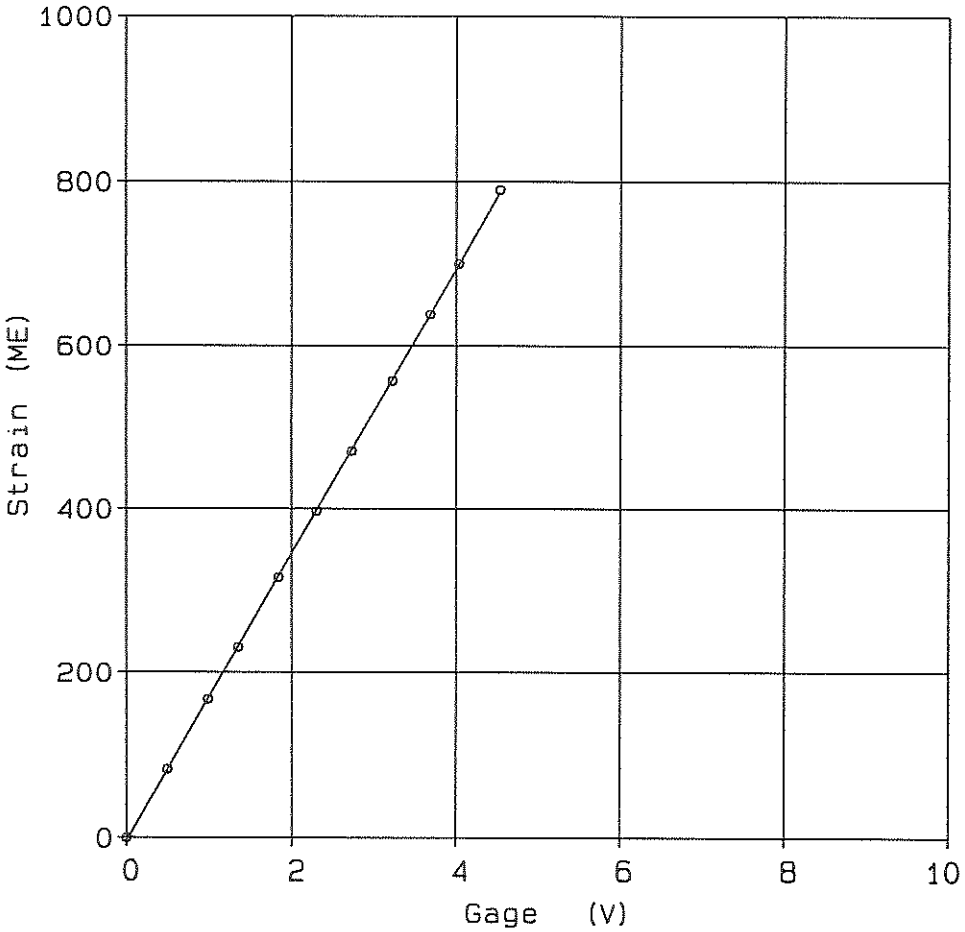

PDA Cal Factor = 174.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 605.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
83	.50
168	.99
232	1.36
317	1.84
398	2.31
472	2.74
558	3.23
639	3.69
702	4.04
791	4.54

Calibrated by: J.S. Lentschoff

Calibrated on: 20-Apr-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2