
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 309W

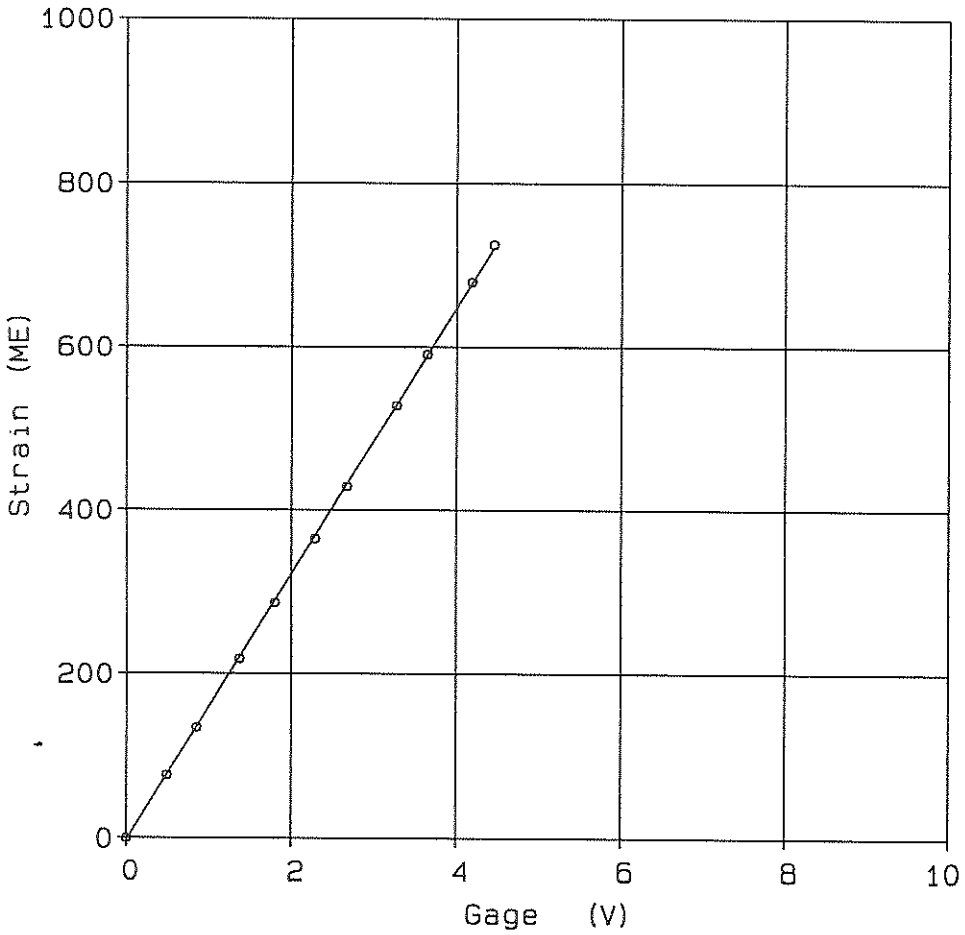

PDA Cal Factor = 163.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 566.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
76	.49
136	.86
219	1.37
288	1.80
365	2.29
430	2.68
529	3.28
591	3.65
680	4.18
726	4.45

Calibrated by: J.E. Deubelbeiss

Calibrated on: 20-Apr-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2