Pile Dynamics, Inc.
Transducer 310W

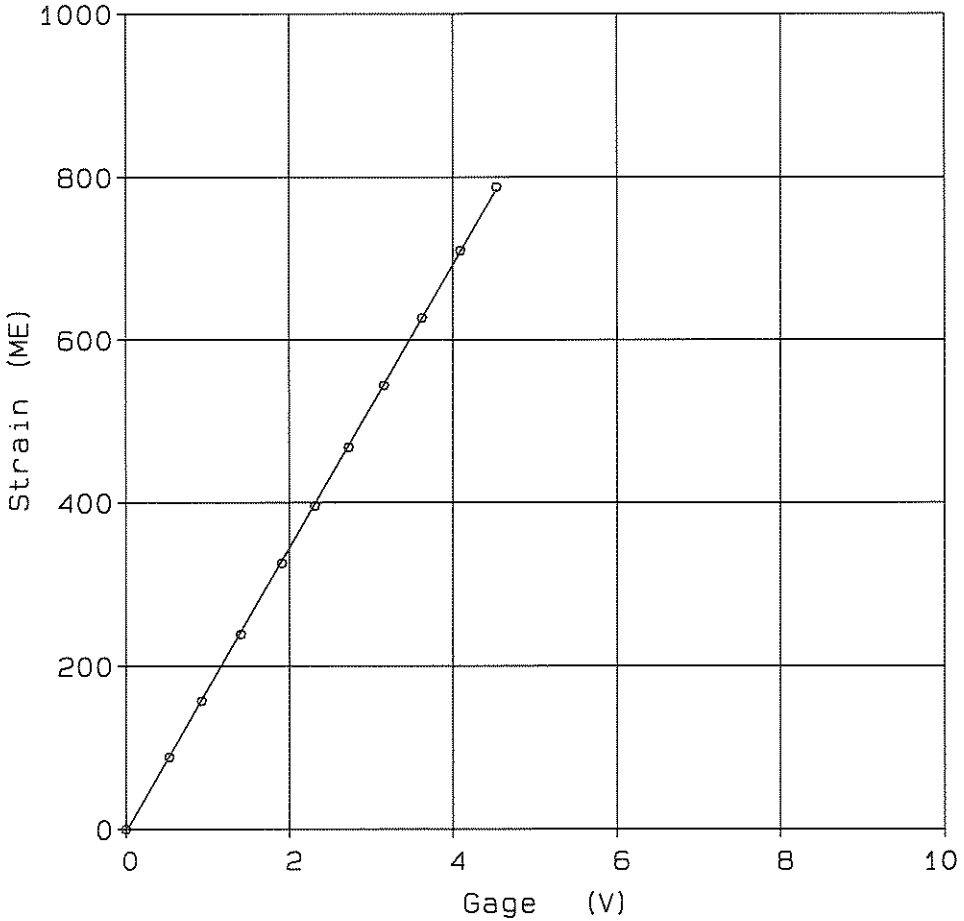

PDA Cal Factor = 174.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 605.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
89	.53
158	.94
240	1.41
326	1.91
396	2.31
469	2.72
544	3.16
627	3.62
711	4.10
789	4.53

Calibrated by: J. Dentsdorff

Calibrated on: 21-Apr-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2