Pile Dynamics, Inc.
Transducer 311W

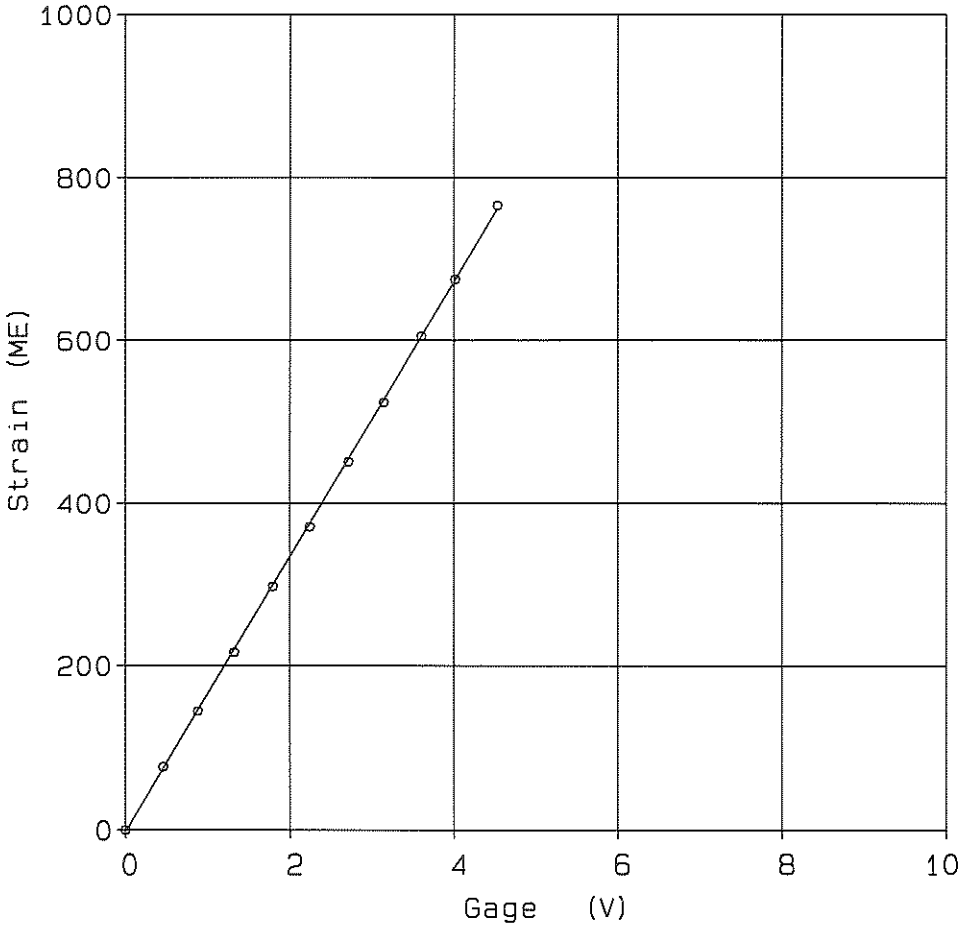

PDA Cal Factor = 168.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 586.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
76	.47
145	.88
217	1.32
297	1.80
371	2.24
452	2.71
524	3.14
605	3.61
675	4.01
767	4.54

Calibrated by: _____

Calibrated on: 21-Apr-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2