Pile Dynamics Inc

Transducer 312W

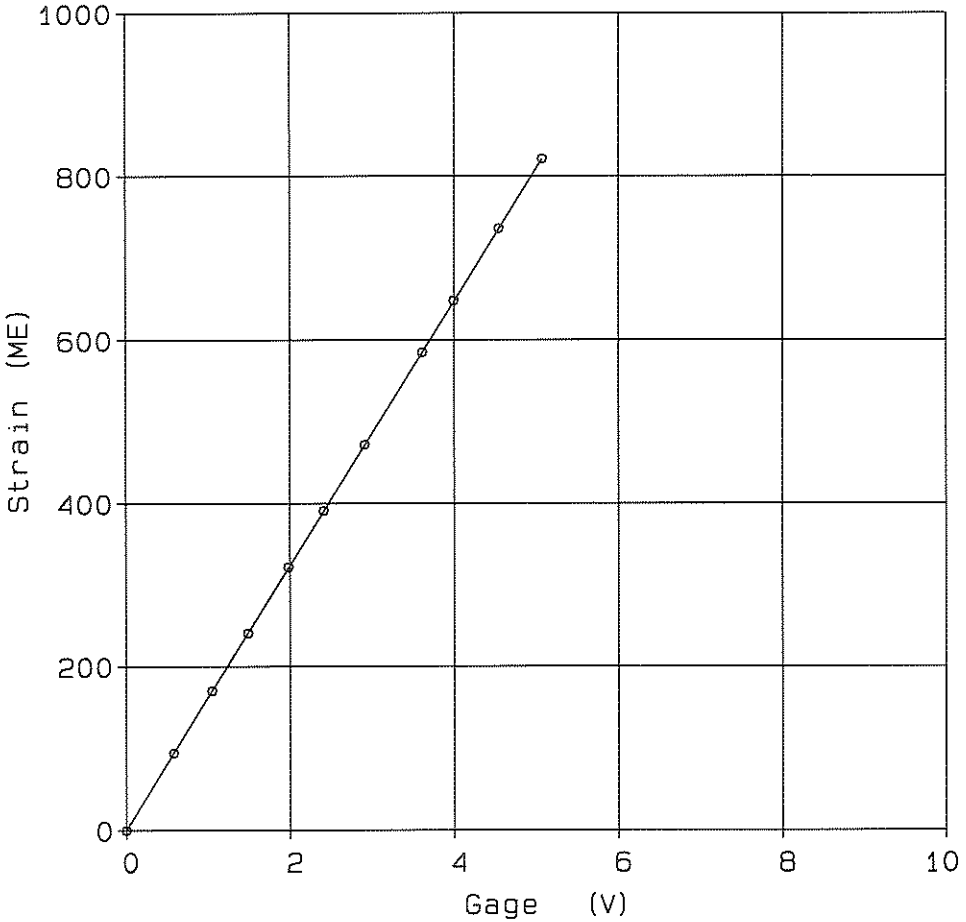

PDA Cal Factor = 162.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 562.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
95	.59
171	1.05
242	1.49
323	1.99
391	2.41
472	2.91
586	3.61
648	4.00
737	4.55
821	5.07

Calibrated by: J. Stevtchoff

Calibrated on: 06-Mar-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2