Pile Dynamics Inc
Transducer 313W

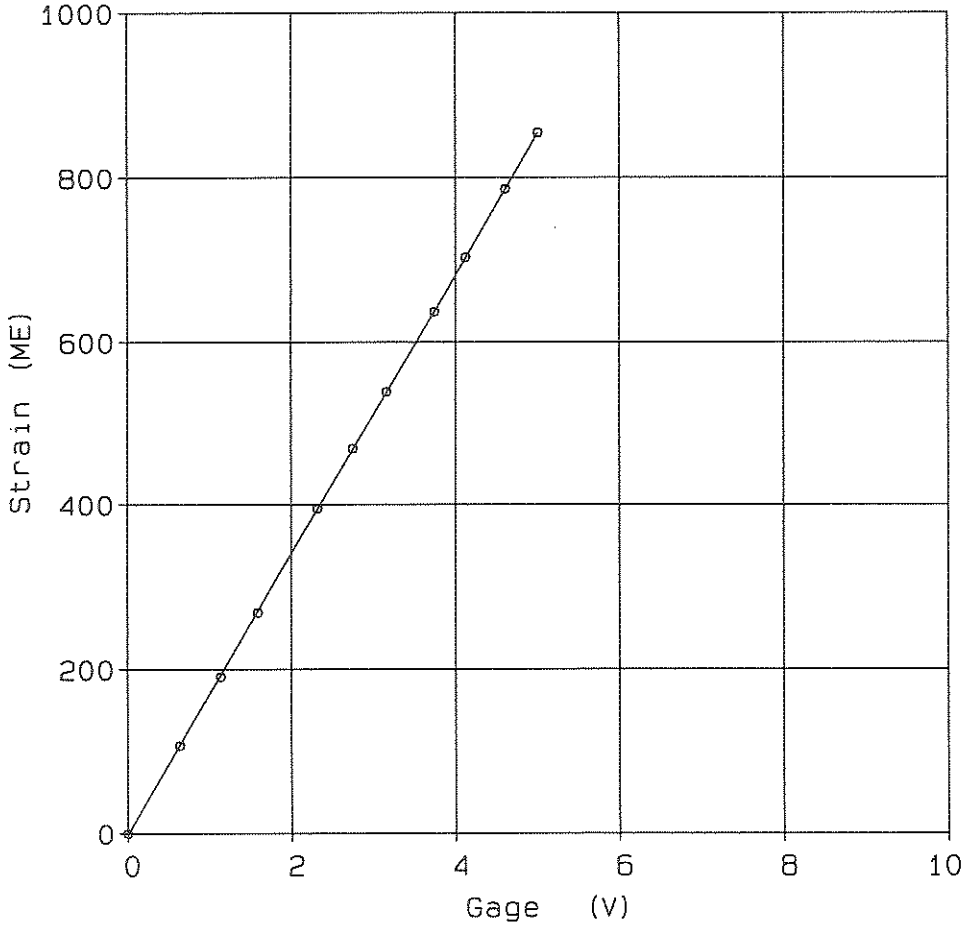

PDA Cal Factor = 170.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 593.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
107	.65
192	1.15
268	1.59
395	2.33
469	2.75
539	3.17
637	3.74
703	4.13
787	4.61
854	5.02

Calibrated by: J. Rantell

Calibrated on: 08-Nov-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2