Pile Dynamics Inc

Transducer 315W

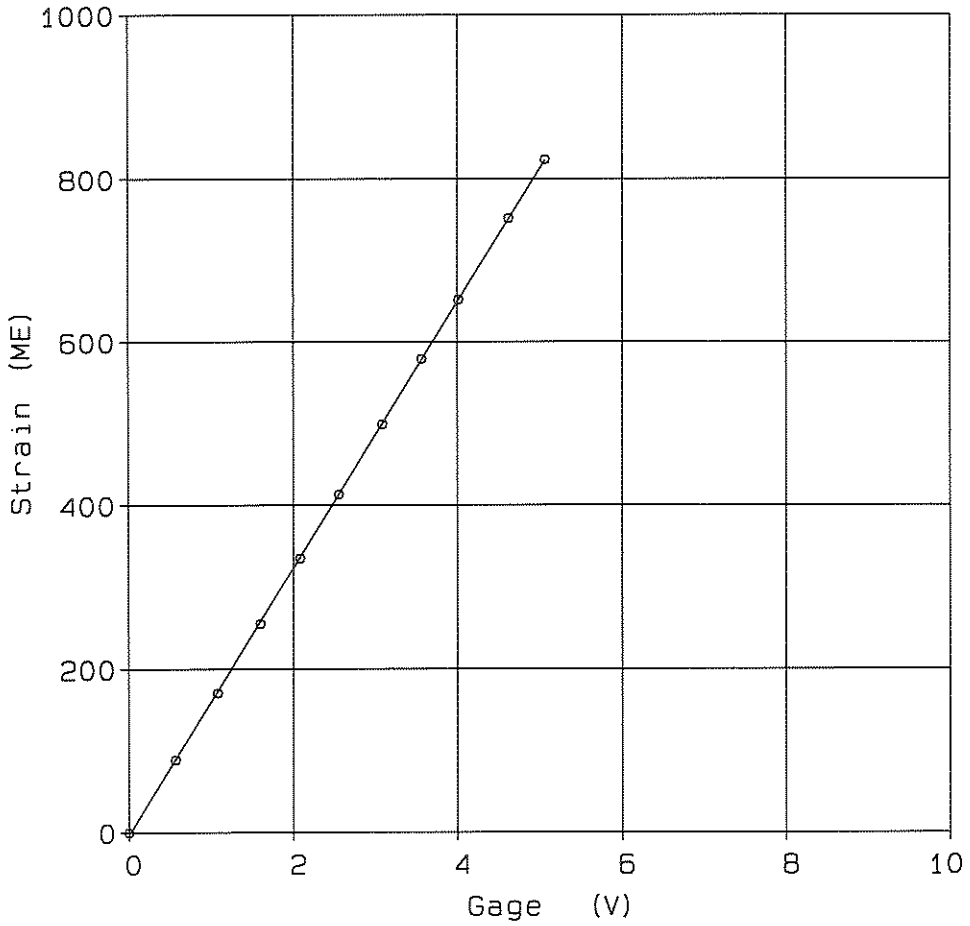

PDA Cal Factor = 163.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 567.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
89	.57
171	1.08
256	1.60
336	2.09
413	2.56
500	3.08
580	3.57
653	4.01
752	4.62
825	5.06

Calibrated by: J. Rentolf

Calibrated on: 06-Mar-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2