Pile Dynamics Inc
Transducer 316W

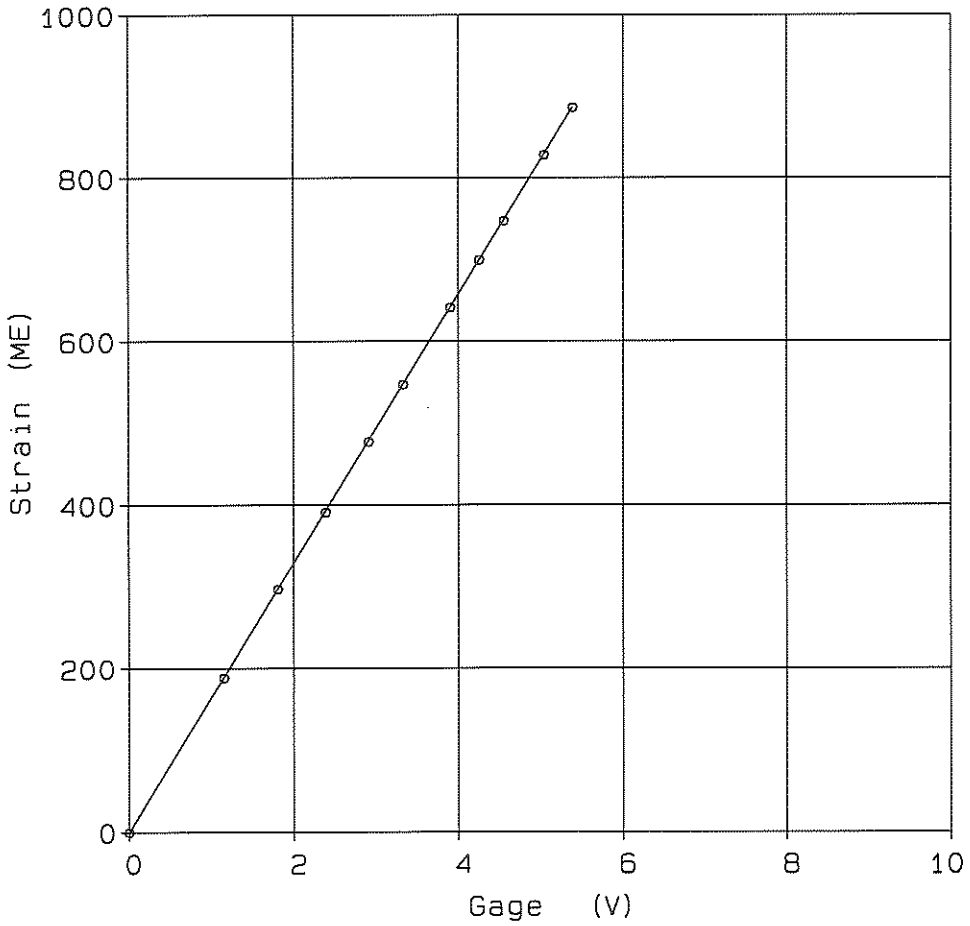

PDA Cal Factor = 164.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 570.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
189	1.16
297	1.82
392	2.39
478	2.91
548	3.33
642	3.90
700	4.26
747	4.55
828	5.05
886	5.40

Calibrated by: J. Costello

Calibrated on: 07-Mar-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2