Pile Dynamics Inc

Transducer 318W

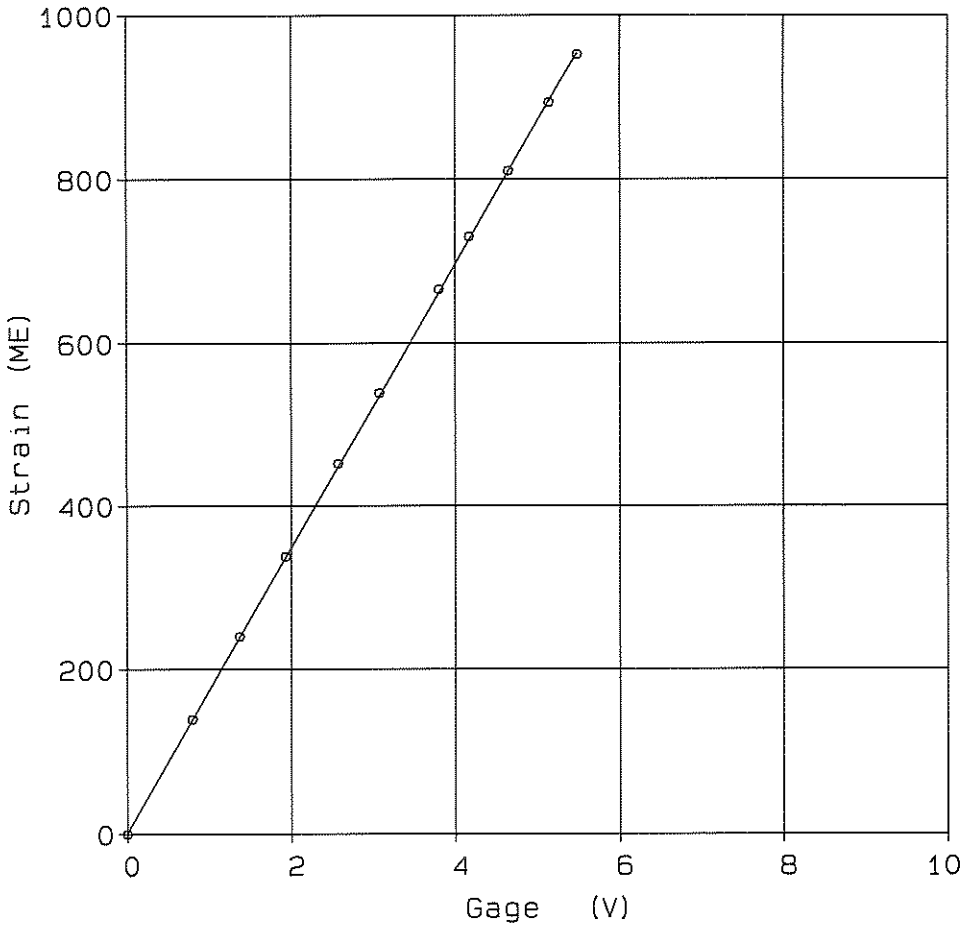

PDA Cal Factor = 173.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 603.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
140	.80
240	1.37
338	1.93
453	2.58
540	3.07
666	3.81
730	4.18
810	4.65
894	5.14
952	5.48

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 06-Mar-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2