Pile Dynamics, Inc.
Transducer 319W

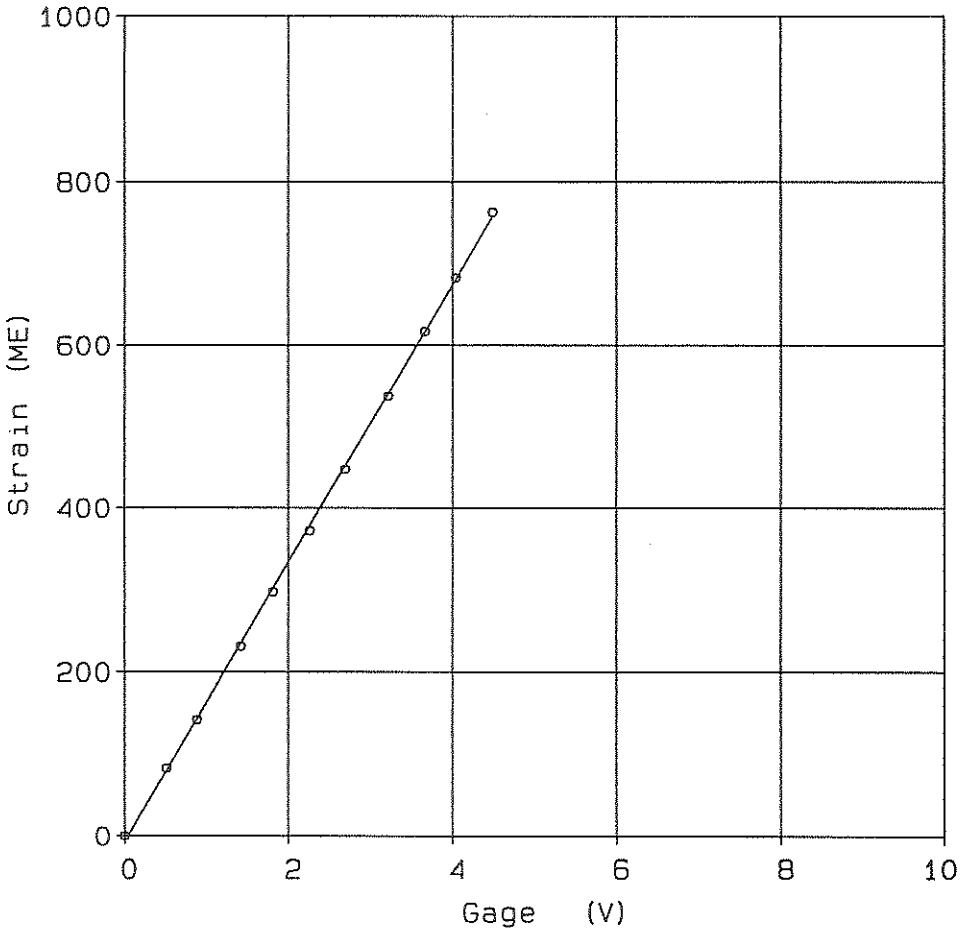

PDA Cal Factor = 170.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 591.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T. *

Strain ME	Gage V
0	.00
83	.52
143	.89
231	1.43
297	1.82
373	2.26
447	2.69
537	3.22
618	3.67
683	4.04
764	4.50

Calibrated by: J. Deutschoff

Calibrated on: 25-Apr-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2