Pile Dynamics, Inc.
Transducer 321W

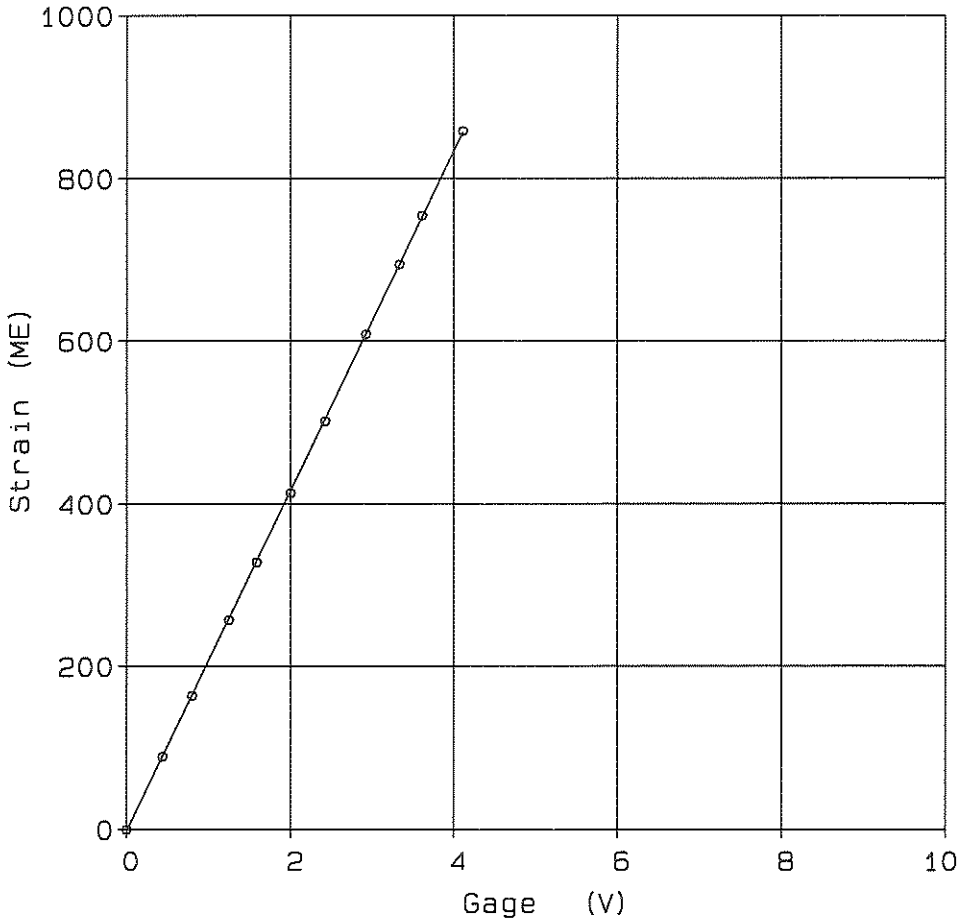

PDA Cal Factor = 209.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 726.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
90	.44
164	.80
257	1.25
329	1.60
414	2.00
502	2.42
608	2.92
695	3.33
755	3.62
859	4.12

Calibrated by: J. Stantchev

Calibrated on: 21-Jun-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2