Pile Dynamics, Inc.
Transducer 322W

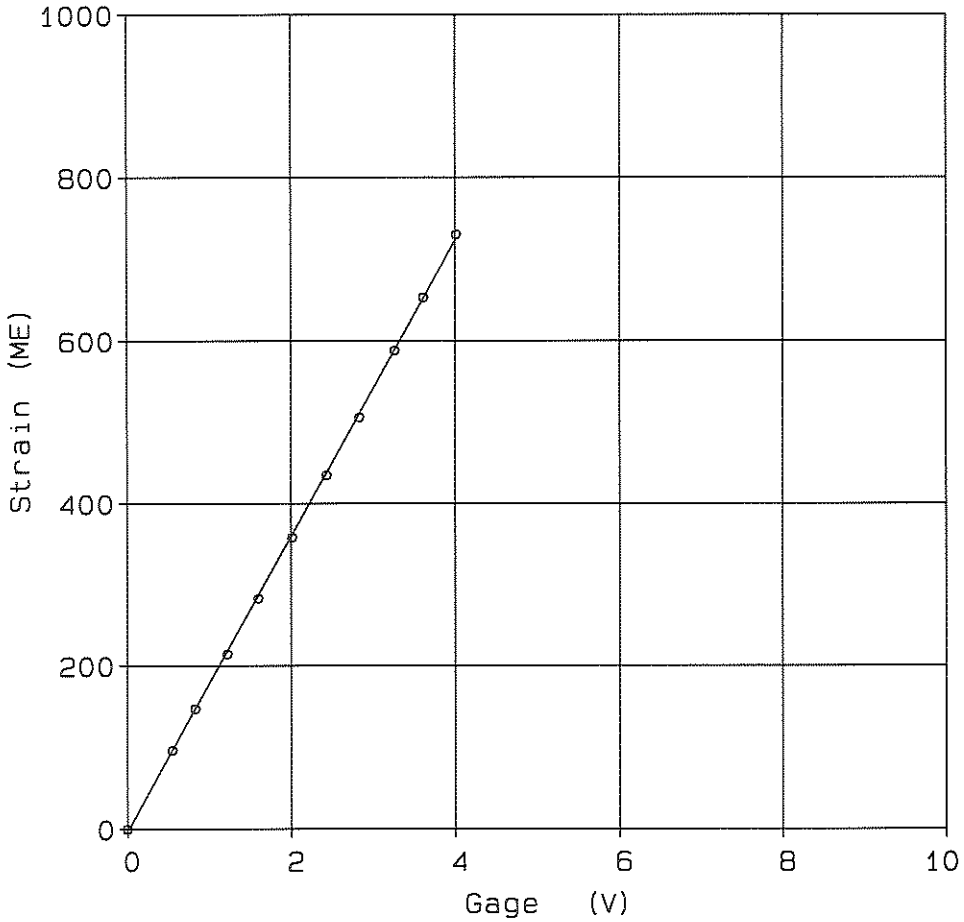

PDA Cal Factor = 181.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 630.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
96	.55
147	.84
215	1.22
284	1.60
359	2.02
435	2.44
507	2.83
588	3.27
654	3.62
730	4.02

Calibrated by: J. S. Rutledge

Calibrated on: 21-Jun-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2