Pile Dynamics, Inc.
Transducer 323W

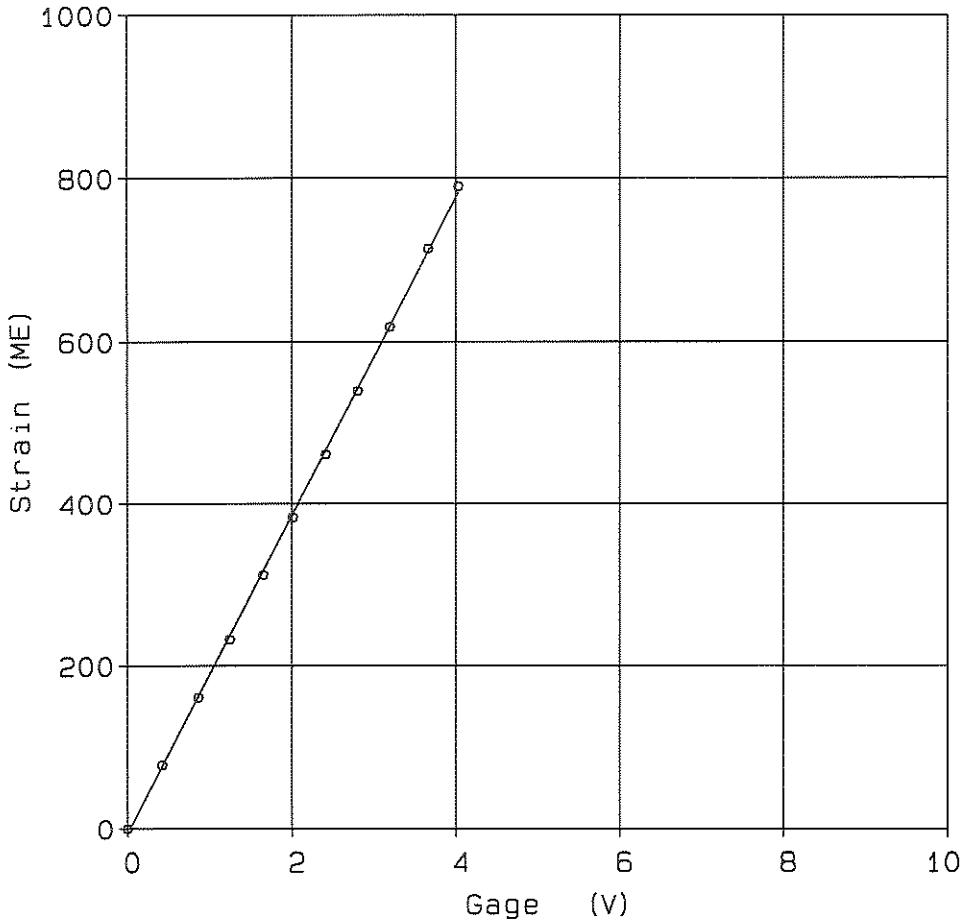

PDA Cal Factor = 196.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 680.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
78	.42
162	.87
233	1.25
312	1.65
384	2.02
462	2.42
540	2.81
618	3.20
715	3.67
791	4.04

Calibrated by: J. Deutschlaff

Calibrated on: 21-Jun-96

Strain Transducer Calibration System -, Version 1994-2