Pile Dynamics, Inc.
Transducer 324W

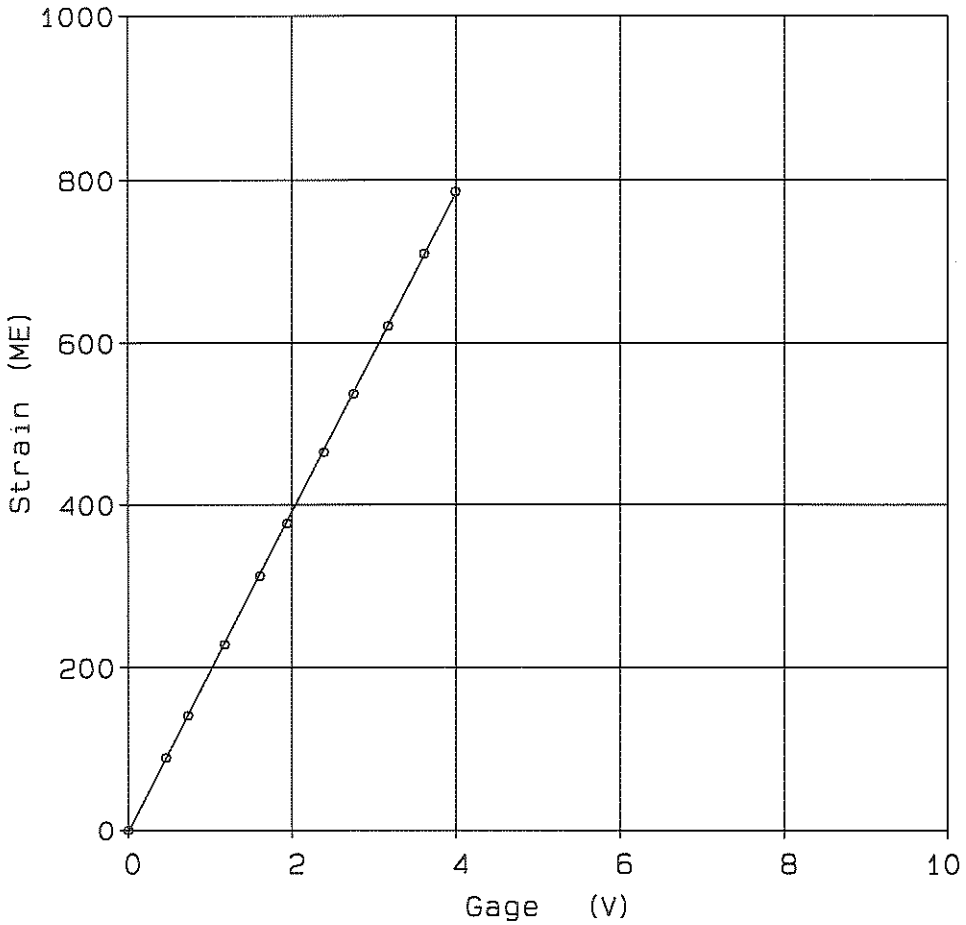

PDA Cal Factor = 196.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 683.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
89	.47
141	.74
228	1.19
312	1.61
378	1.95
466	2.39
537	2.75
621	3.17
711	3.62
786	4.00

Calibrated by: J. Deutschlaff

Calibrated on: 21-Jun-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2