Pile Dynamics, Inc.
Transducer 325W

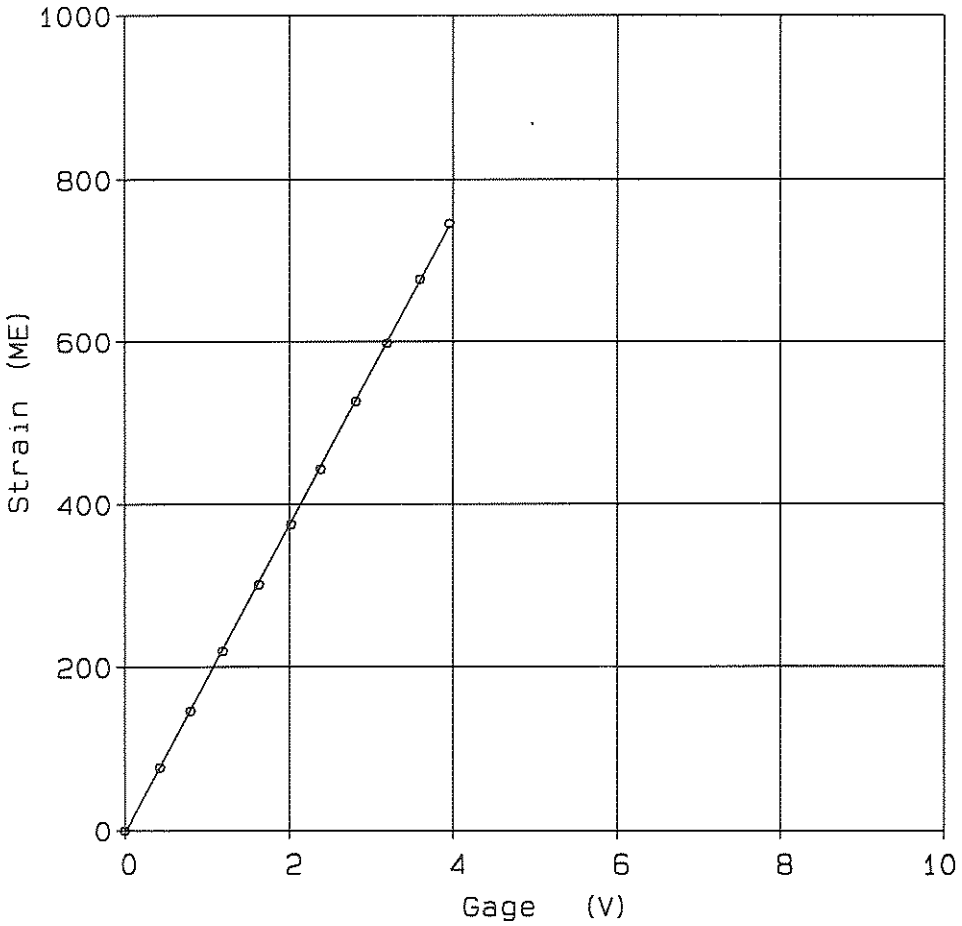

PDA Cal Factor = 189.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 656.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
77	.43
147	.81
219	1.20
301	1.64
375	2.03
443	2.38
527	2.82
599	3.19
678	3.60
746	3.96

Calibrated by: J. Dentstaff

Calibrated on: 21-Jun-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2