Pile Dynamics, Inc.
Transducer 326W

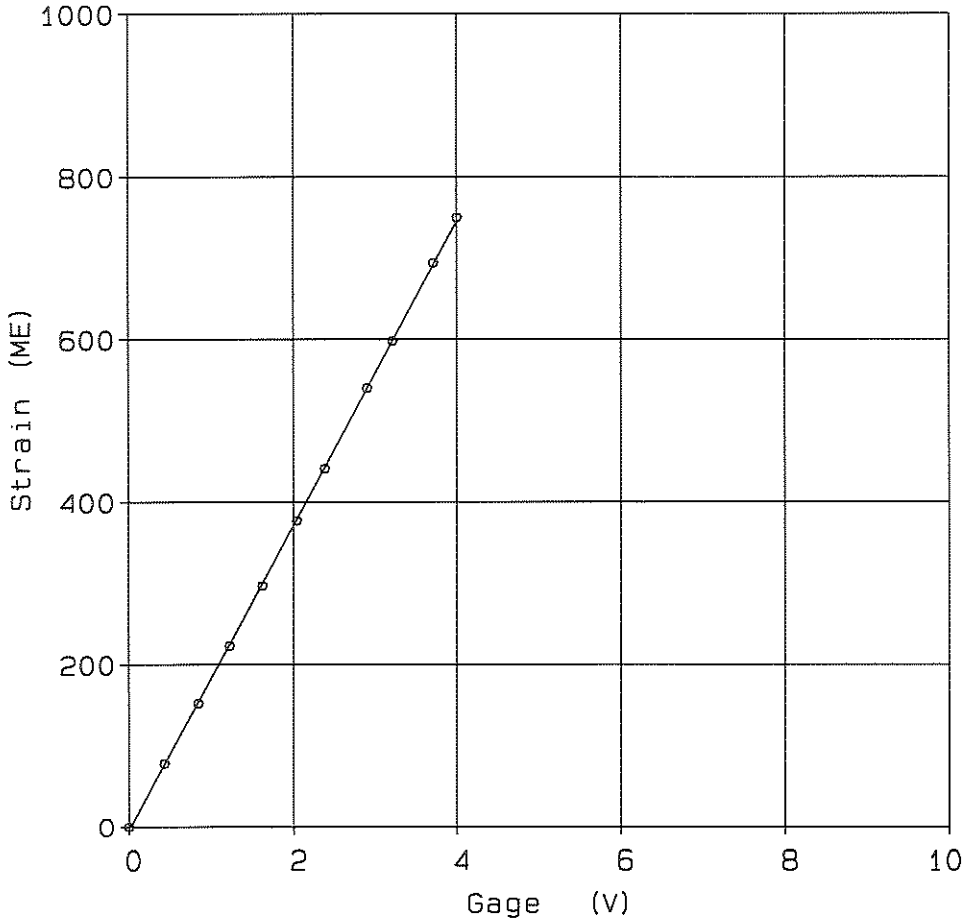

PDA Cal Factor = 187.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 652.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
79	.44
152	.84
223	1.22
297	1.62
377	2.05
442	2.39
540	2.91
599	3.21
694	3.71
750	4.00

Calibrated by: J. Stantelli

Calibrated on: 21-Jun-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2