Pile Dynamics, Inc.
Transducer 327W

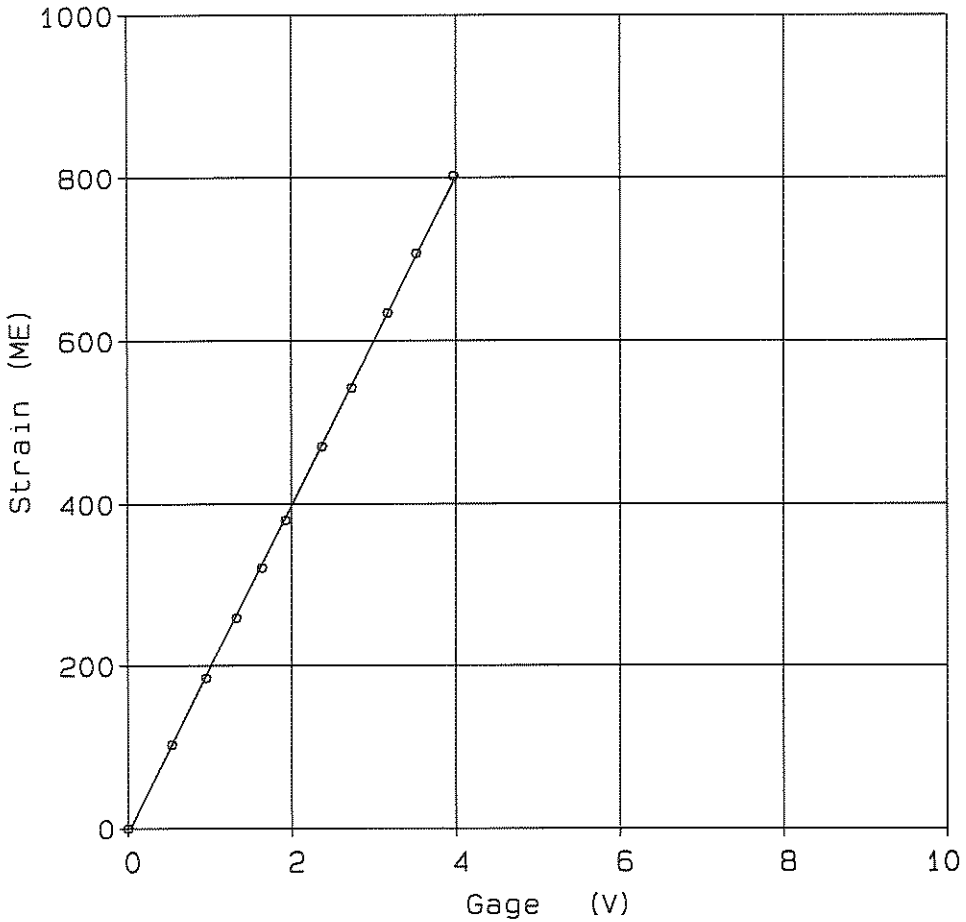

PDA Cal Factor = 202.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 702.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
104	.54
186	.96
259	1.33
322	1.64
381	1.93
471	2.38
542	2.73
635	3.18
707	3.52
803	3.97

Calibrated by: _____

Calibrated on: 21-Jun-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2