Pile Dynamics, Inc.

Transducer 328W

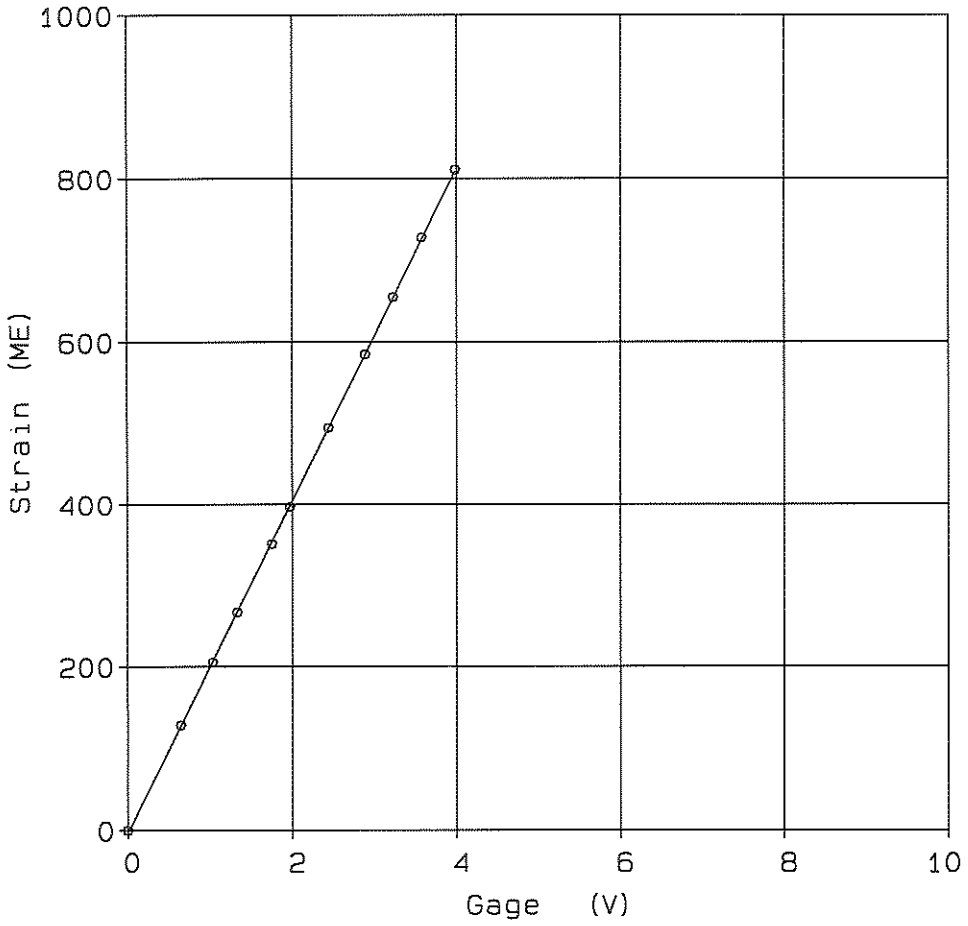

PDA Cal Factor = 204.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 709.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
128	.65
205	1.03
268	1.34
352	1.75
398	1.98
495	2.45
585	2.89
655	3.23
729	3.58
812	3.98

Calibrated by: J. Deutschlaff

Calibrated on: 21-Jun-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2