Pile Dynamics, Inc.
Transducer 330W

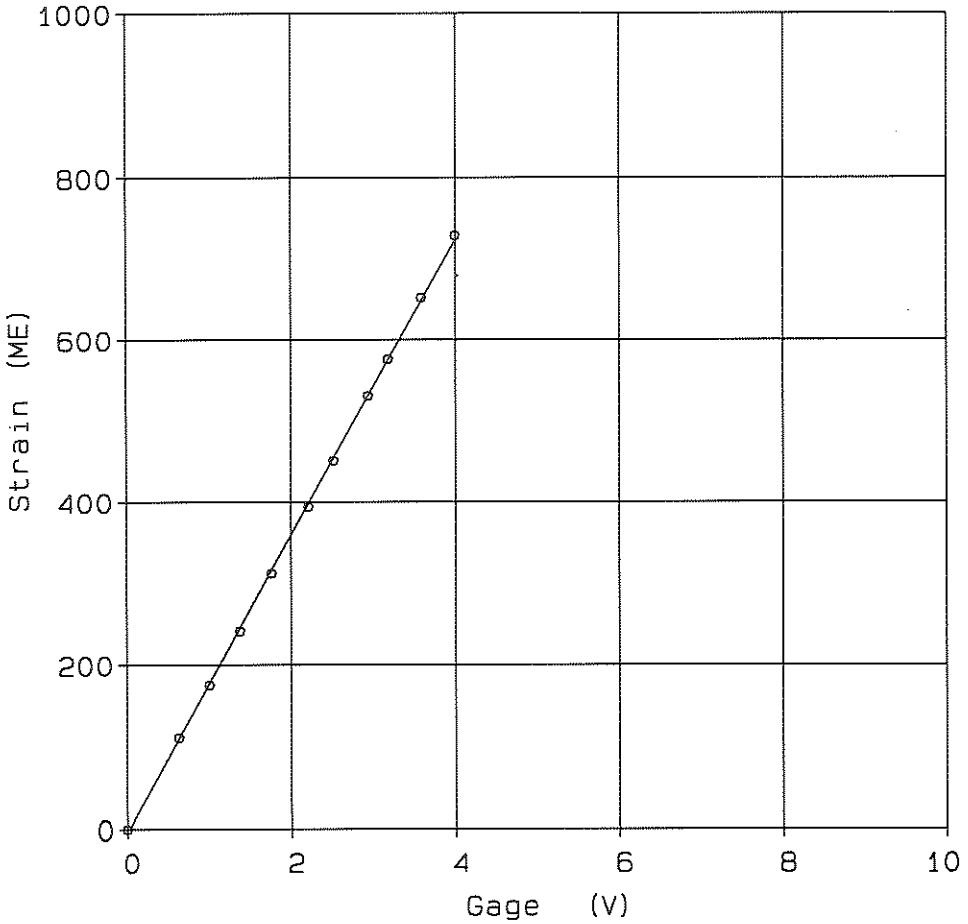

PDA Cal Factor = 182.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 634.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
112	.64
176	1.00
242	1.37
312	1.77
394	2.21
452	2.52
532	2.95
576	3.19
652	3.59
729	4.00

Calibrated by: J. S. Rutledge

Calibrated on: 21-Jun-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2