Pile Dynamics, Inc.
Transducer 331W

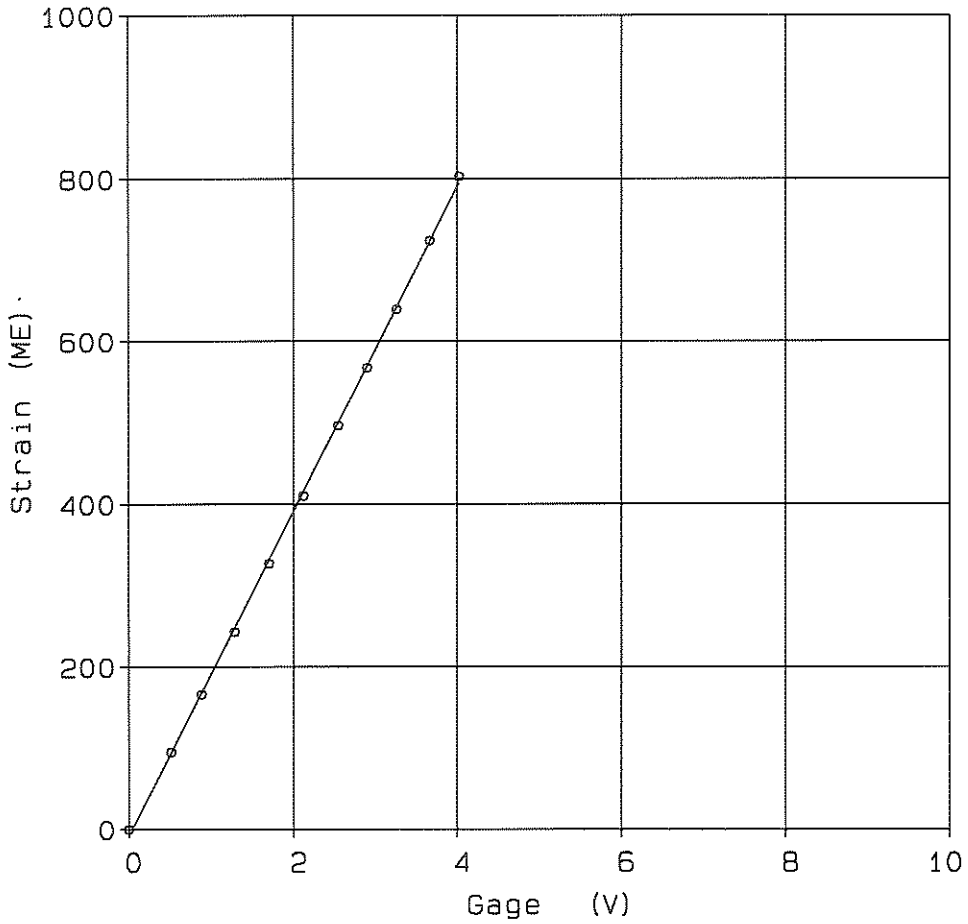

PDA Cal Factor = 199.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 693.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
96	.51
166	.88
244	1.28
327	1.70
411	2.12
497	2.55
568	2.90
639	3.25
724	3.66
804	4.03

Calibrated by: J. Deutschelf

Calibrated on: 21-Jun-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2