Pile Dynamics, Inc.
Transducer 332W

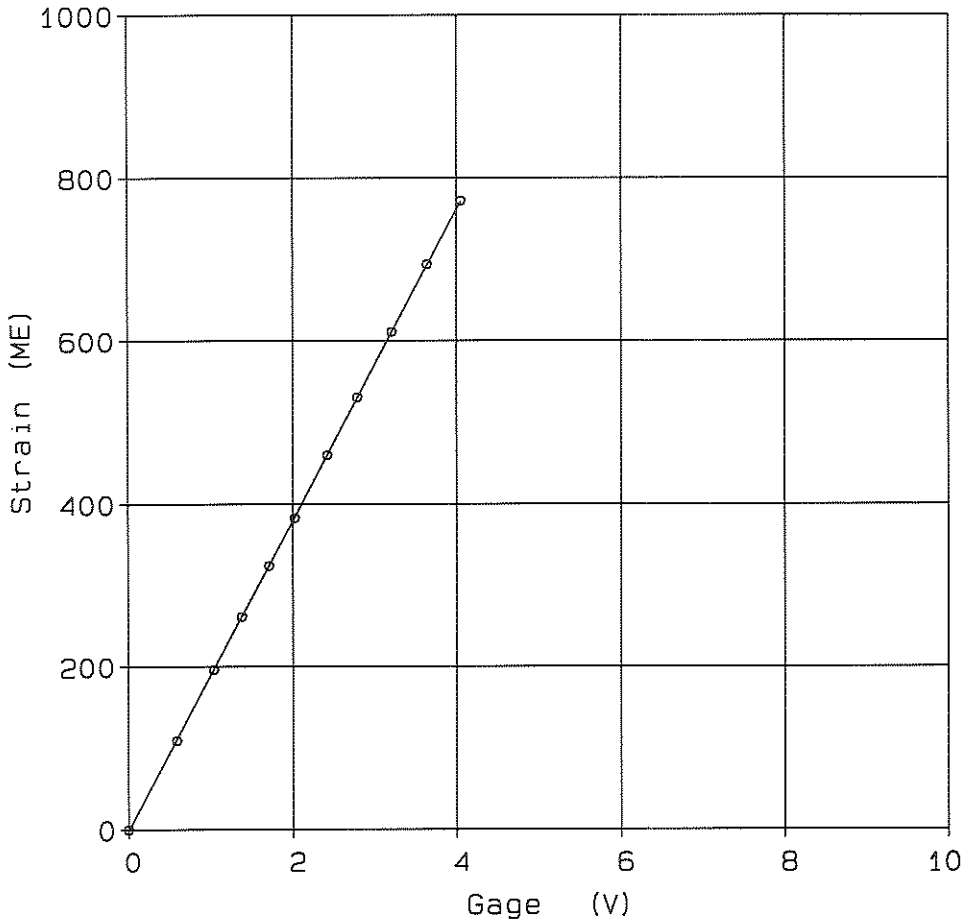

PDA Cal Factor = 190.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 662.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
110	.59
196	1.04
261	1.39
324	1.72
383	2.02
460	2.43
532	2.80
611	3.21
695	3.65
772	4.06

Calibrated by: _____

Calibrated on: 21-Jun-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2