Pile Dynamics, Inc.
Transducer 333W

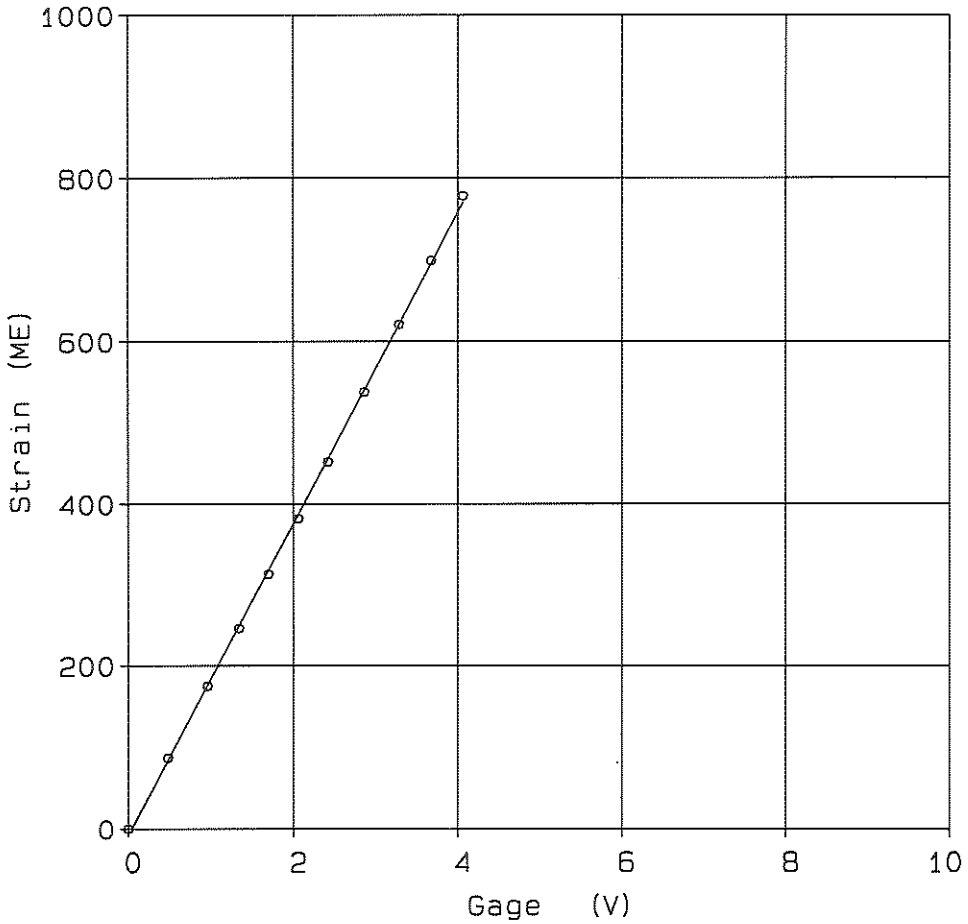

PDA Cal Factor = 191.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 666.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
88	.49
175	.97
246	1.35
314	1.71
382	2.06
453	2.43
538	2.87
621	3.28
700	3.67
778	4.06

Calibrated by: J. Pentkowski

Calibrated on: 21-Jun-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2