Pile Dynamics, Inc.
Transducer 334W

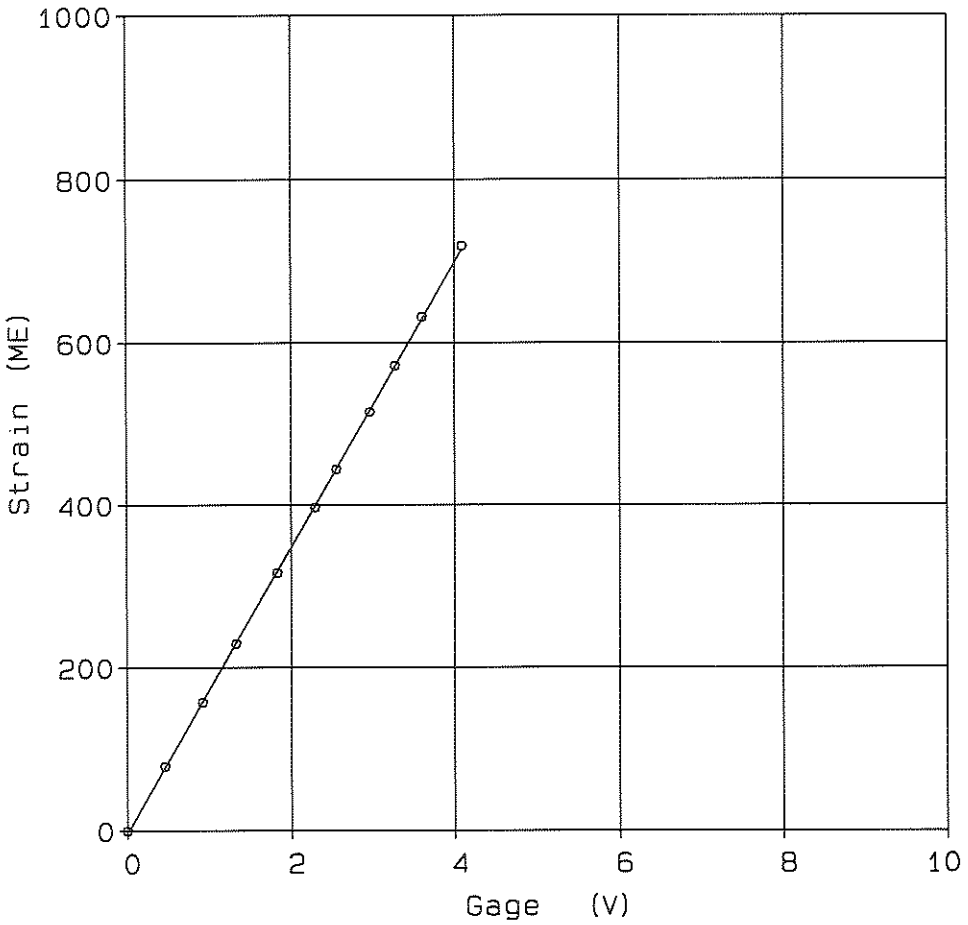

PDA Cal Factor	=	176.1 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	611.3 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
80	.47
158	.93
229	1.34
316	1.84
398	2.30
444	2.56
516	2.96
572	3.27
632	3.61
719	4.09

Calibrated by: J. E. Stewart

Calibrated on: 21-Jun-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2