
Pile Dynamics Inc

Transducer 351W

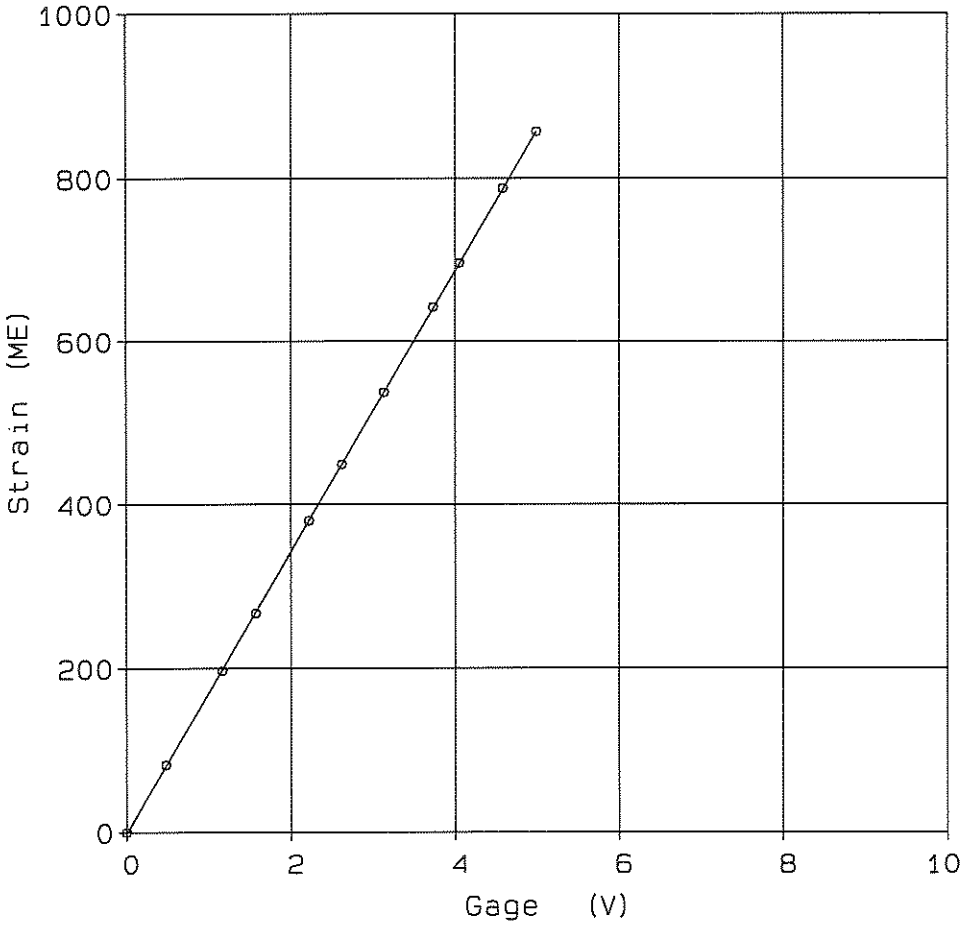

PDA Cal Factor = 172.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 598.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
82	.49
197	1.16
267	1.57
380	2.22
449	2.63
538	3.14
643	3.74
697	4.05
788	4.58
857	4.99

Calibrated by: J. Rentsch

Calibrated on: 06-Mar-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2