
Pile Dynamics, Inc.

Transducer 354W

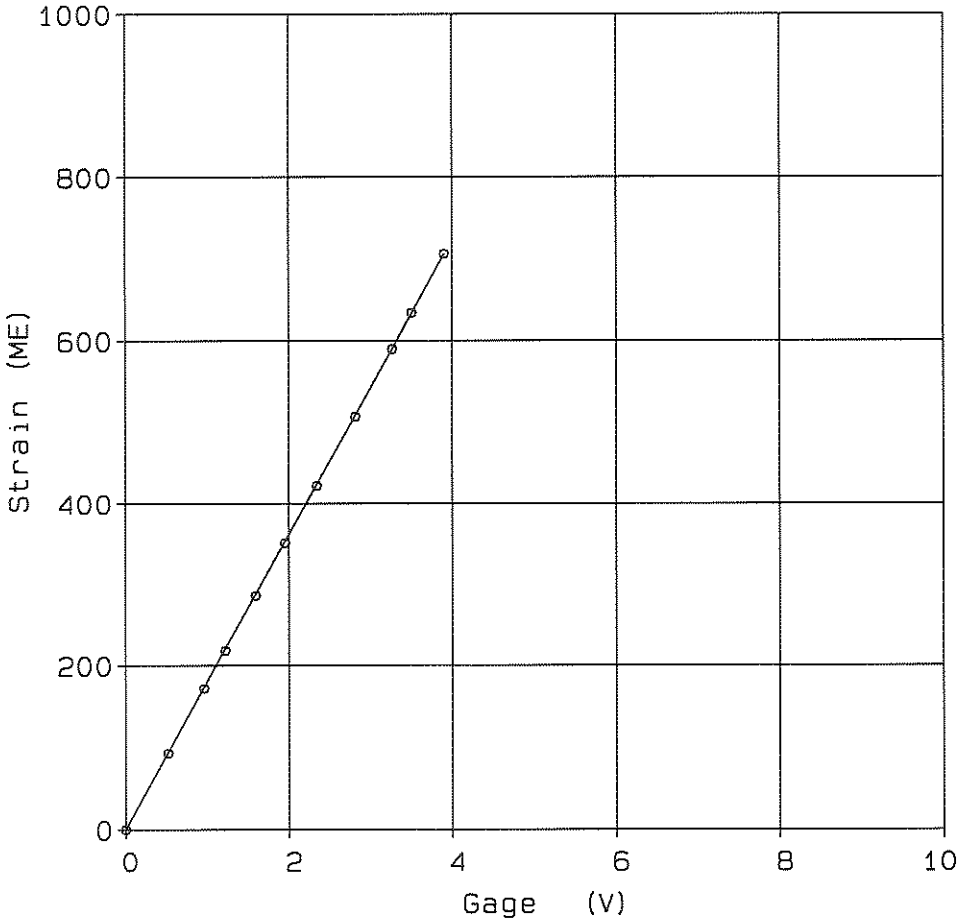

PDA Cal Factor = 181.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 628.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
94	.53
172	.97
219	1.22
287	1.60
352	1.96
422	2.34
507	2.81
590	3.27
635	3.51
707	3.91

Calibrated by: J. S. Stuckey Jr.

Calibrated on: 15-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2