
Pile Dynamics Inc
Transducer 356W

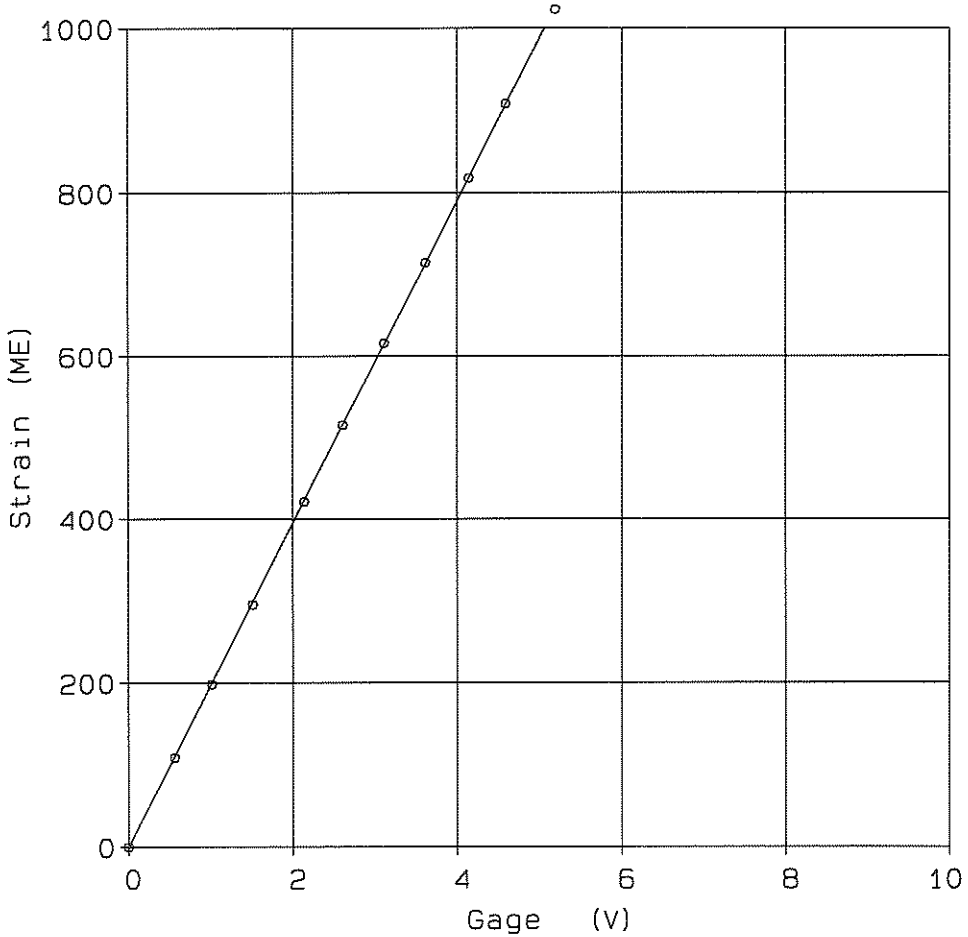

PDA Cal Factor = 197.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 687.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
110	.57
198	1.02
296	1.51
421	2.14
516	2.61
617	3.12
715	3.62
819	4.14
908	4.60
1023	5.19

Calibrated by: J. Gentilcore

Calibrated on: 06-Mar-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2