
Pile Dynamics, Inc.

Transducer 358W

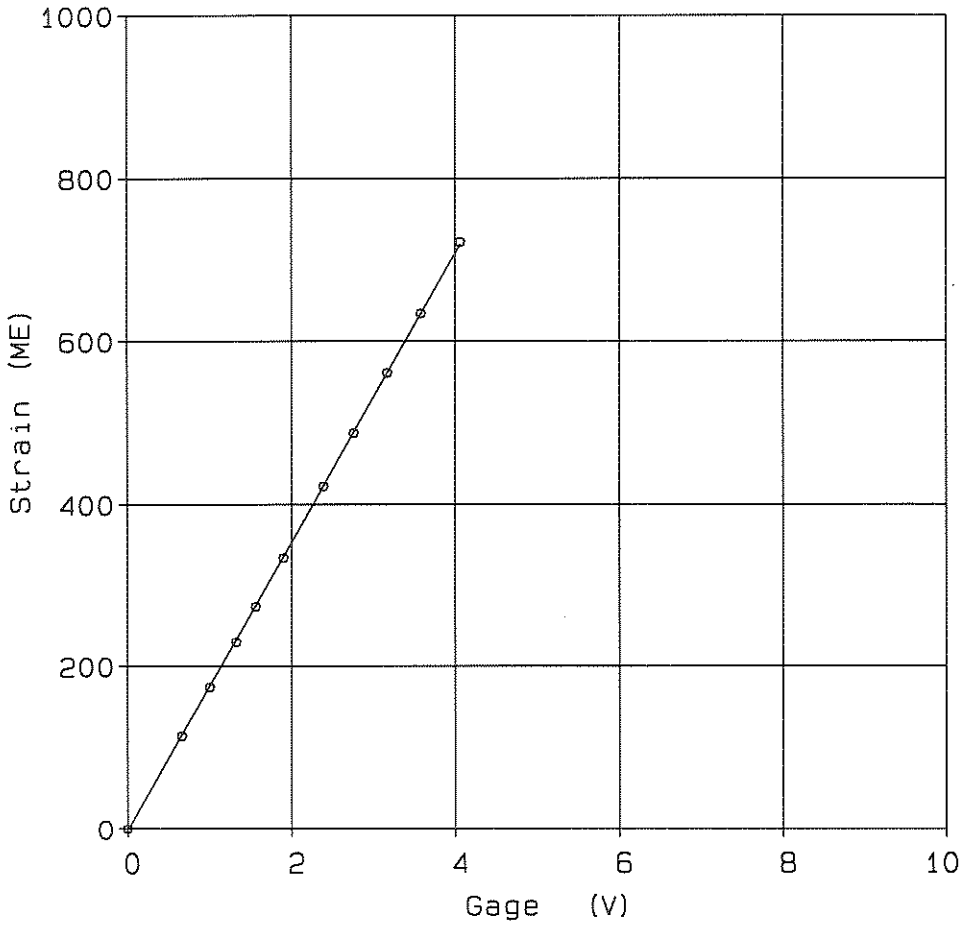

PDA Cal Factor = 178.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 617.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
115	.66
174	1.00
231	1.32
275	1.57
334	1.90
422	2.40
488	2.76
562	3.17
635	3.58
722	4.06

Calibrated by: J. Rausche

Calibrated on: 15-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2