
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 362W

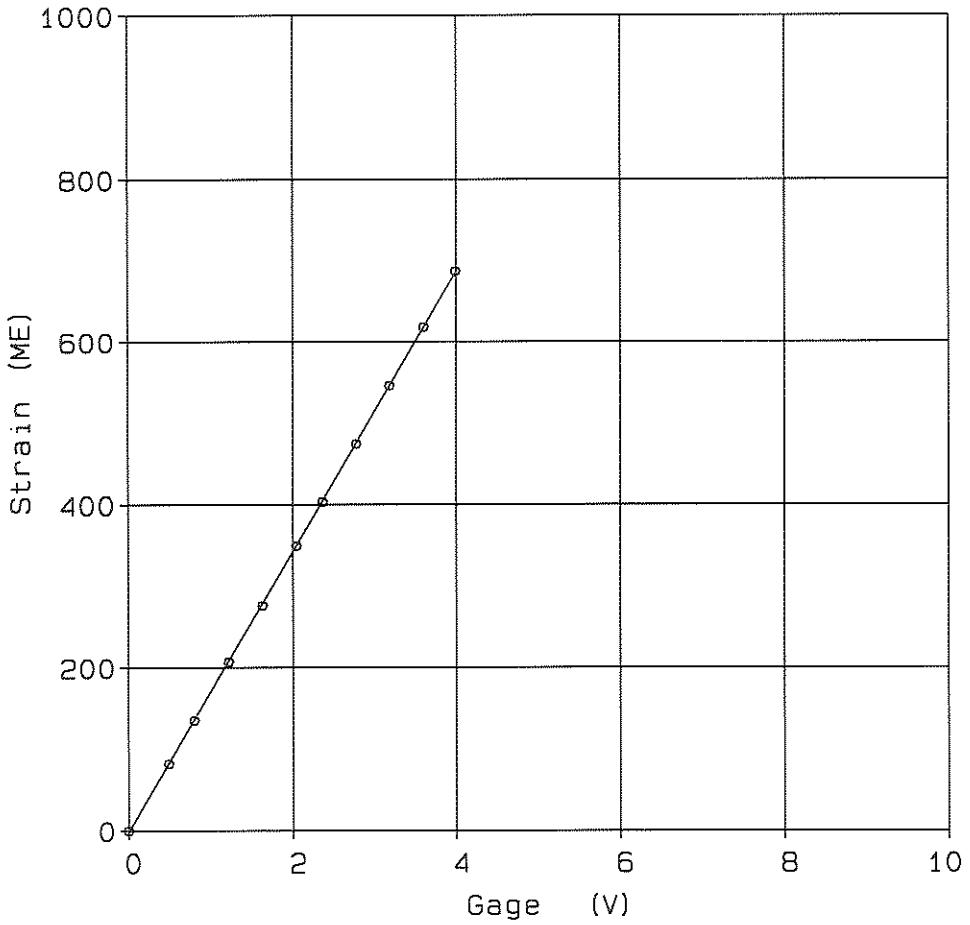

PDA Cal Factor = 172.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 598.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
83	.49
135	.80
207	1.22
277	1.63
349	2.05
403	2.36
474	2.77
546	3.19
619	3.60
687	3.99

Calibrated by: J. E. Rausche

Calibrated on: 15-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2