
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 363W

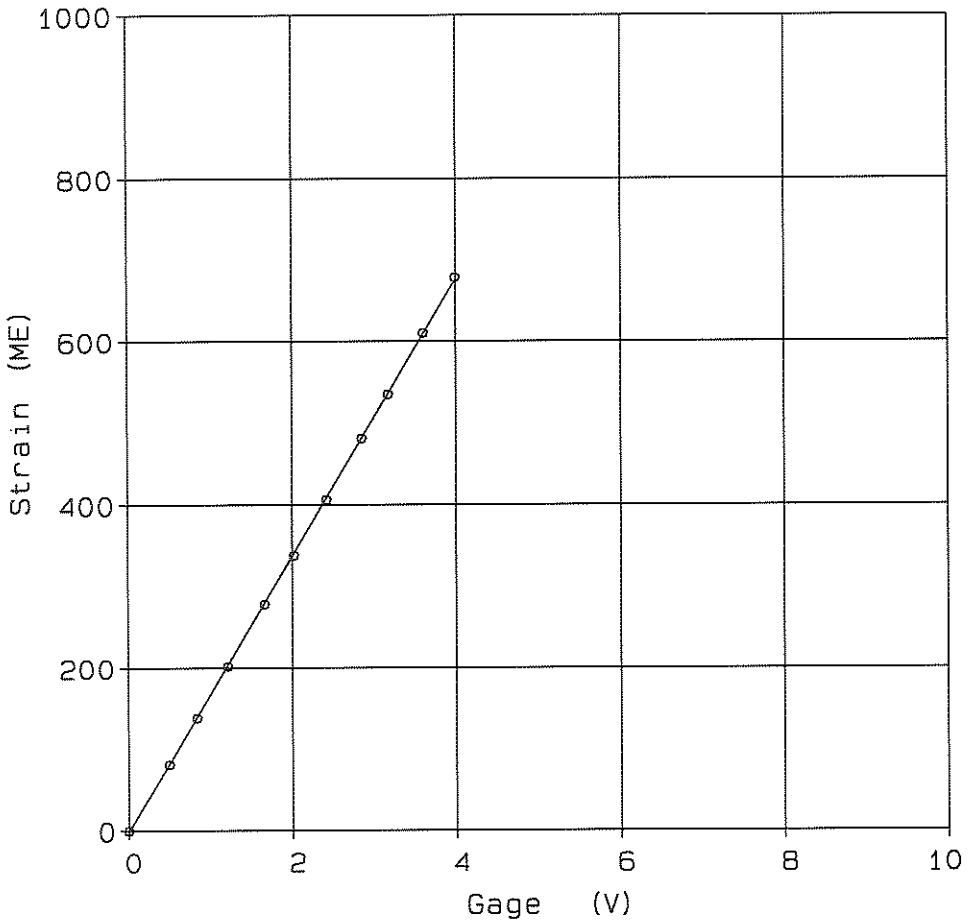

PDA Cal Factor = 169.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 590.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
82	.50
139	.84
202	1.22
279	1.67
339	2.02
407	2.42
482	2.86
536	3.17
611	3.61
678	4.00

Calibrated by: J. Deutschmidt

Calibrated on: 15-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2