
Pile Dynamics, Inc.

Transducer 364W

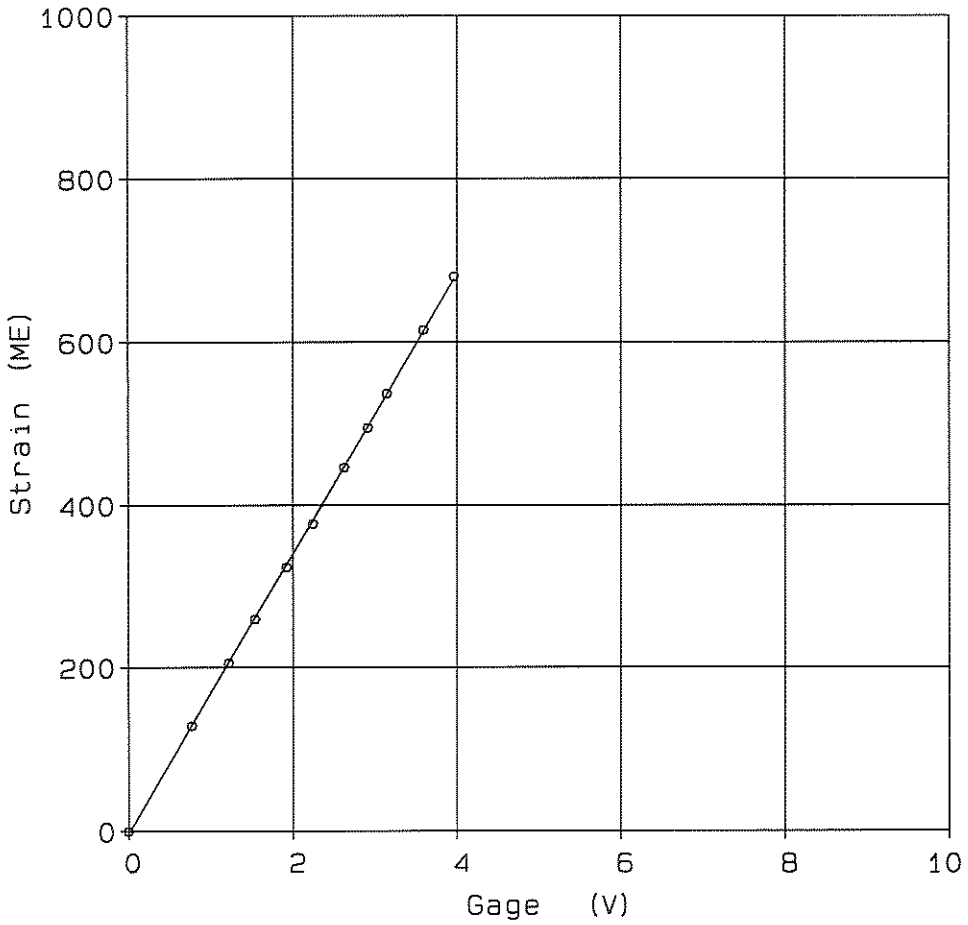

PDA Cal Factor	=	171.9 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	596.9 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
129	.77
206	1.23
259	1.55
323	1.93
378	2.25
446	2.63
496	2.91
537	3.15
615	3.59
681	3.97

Calibrated by: J. Rausterlaff

Calibrated on: 15-Aug-96