
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 366W

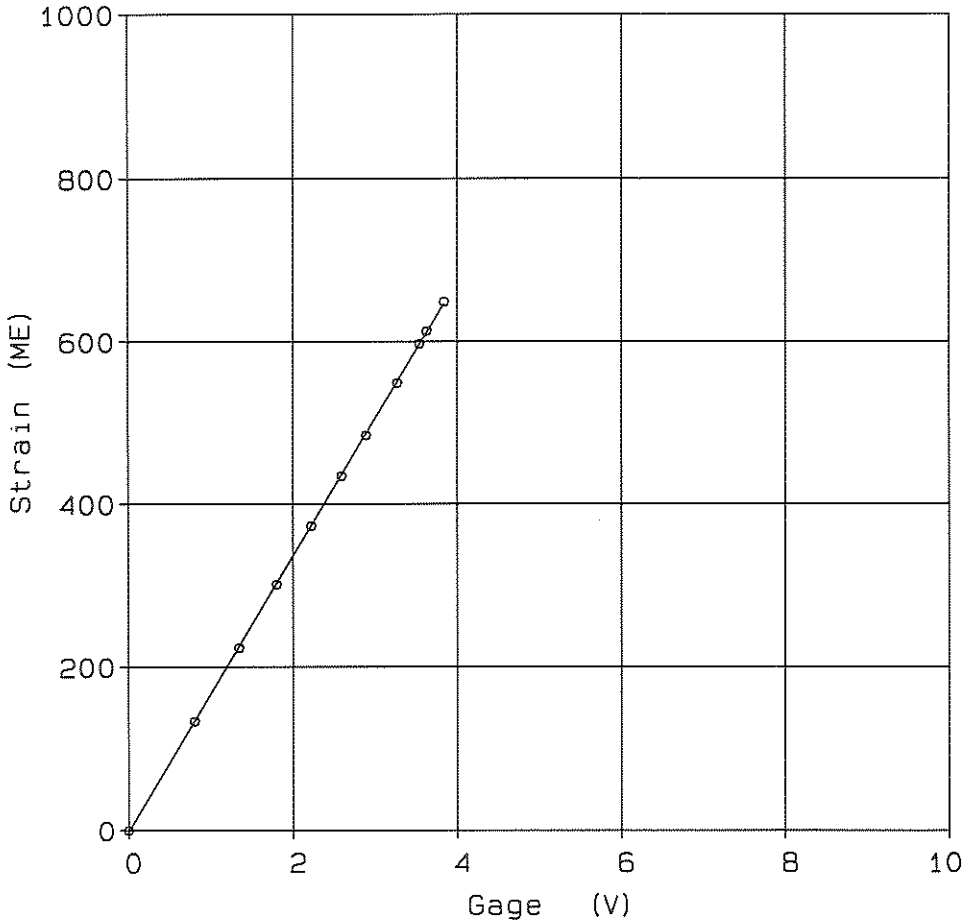

PDA Cal Factor = 168.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 586.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
133	.81
223	1.34
301	1.80
374	2.23
435	2.59
485	2.89
549	3.27
598	3.55
613	3.64
649	3.85

Calibrated by: J. Rausche

Calibrated on: 15-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2