
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 368W

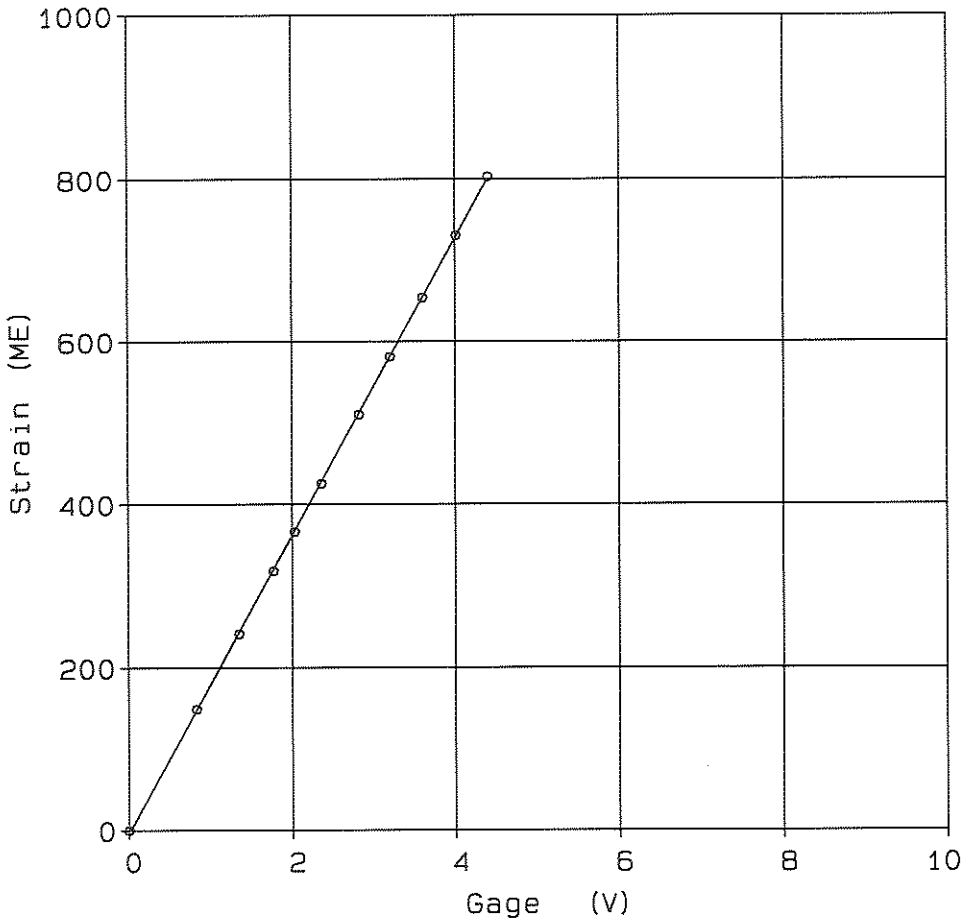

PDA Cal Factor = 182.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 634.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
150	.84
242	1.35
318	1.77
367	2.04
426	2.36
511	2.82
581	3.21
655	3.60
731	4.02
803	4.41

Calibrated by: J. Rausche

Calibrated on: 18-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2