
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 370W

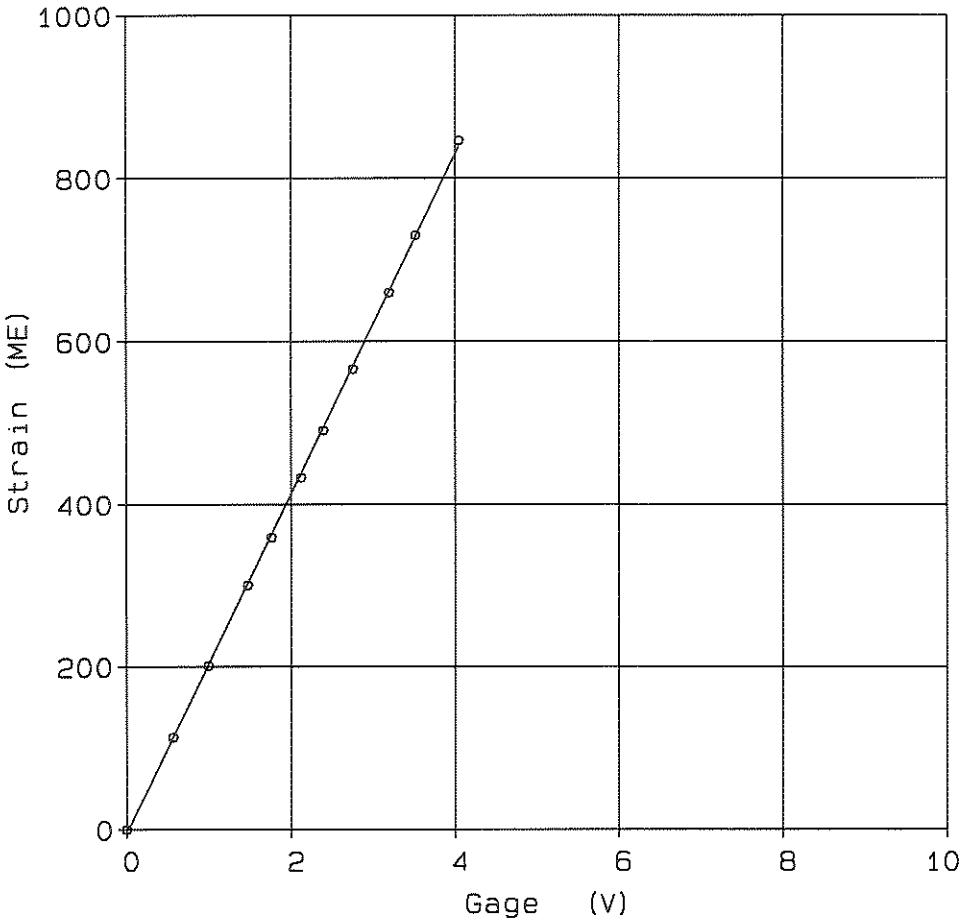

PDA Cal Factor = 208.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 724.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
114	.57
201	.99
301	1.48
359	1.76
433	2.12
491	2.40
566	2.75
660	3.19
731	3.52
846	4.05

Calibrated by: J. S. Dunkelberger

Calibrated on: 18-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2