
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 371W

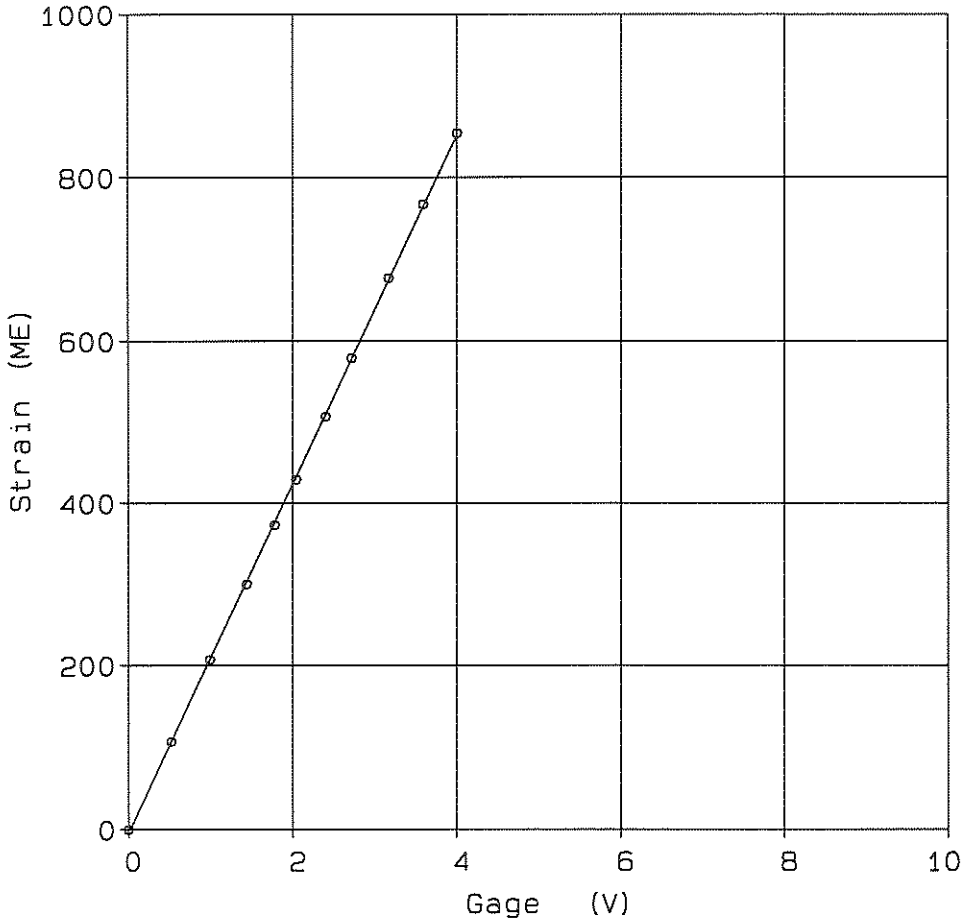

PDA Cal Factor = 214.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 744.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
108	.52
207	1.00
300	1.44
374	1.79
430	2.05
508	2.41
580	2.73
677	3.17
768	3.60
854	4.00

Calibrated by: J.E. Turtschaff

Calibrated on: 18-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2