
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 372W

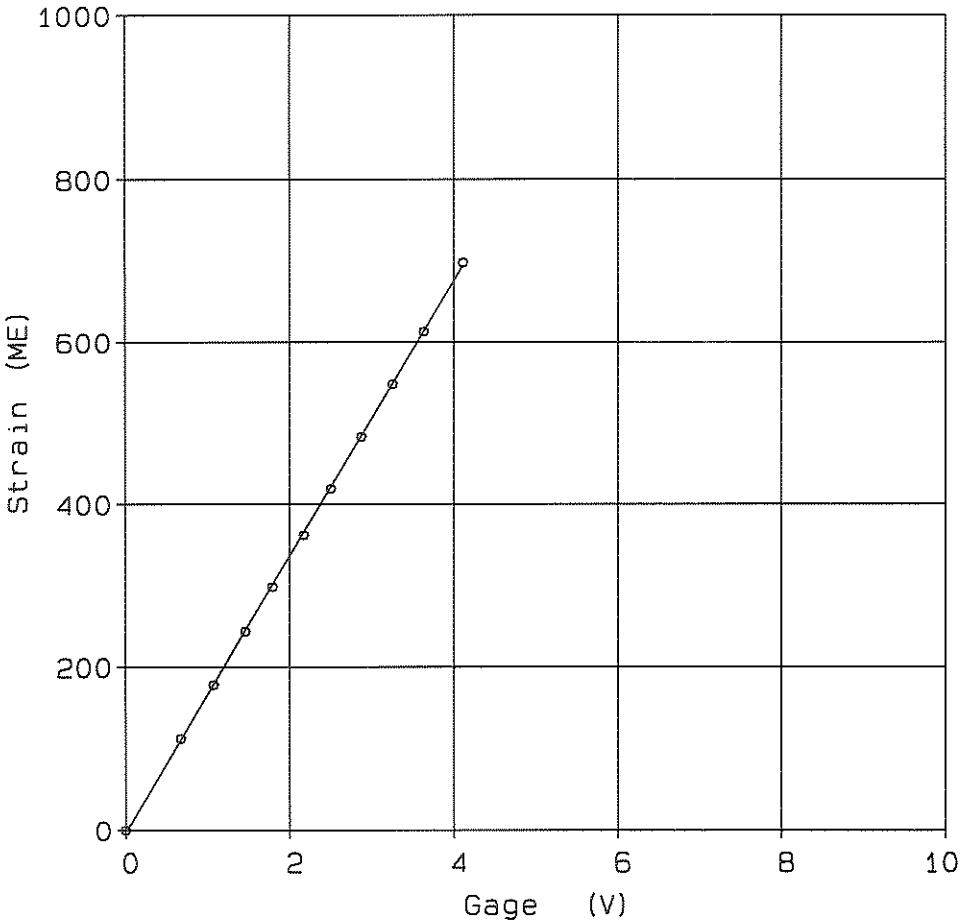

PDA Cal Factor = 169.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 589.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
112	.68
178	1.08
243	1.46
299	1.79
363	2.17
419	2.50
483	2.88
548	3.26
614	3.63
698	4.12

Calibrated by: J. S. Tomlinson

Calibrated on: 18-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2