Pile Dynamics, Inc.
Transducer 373W

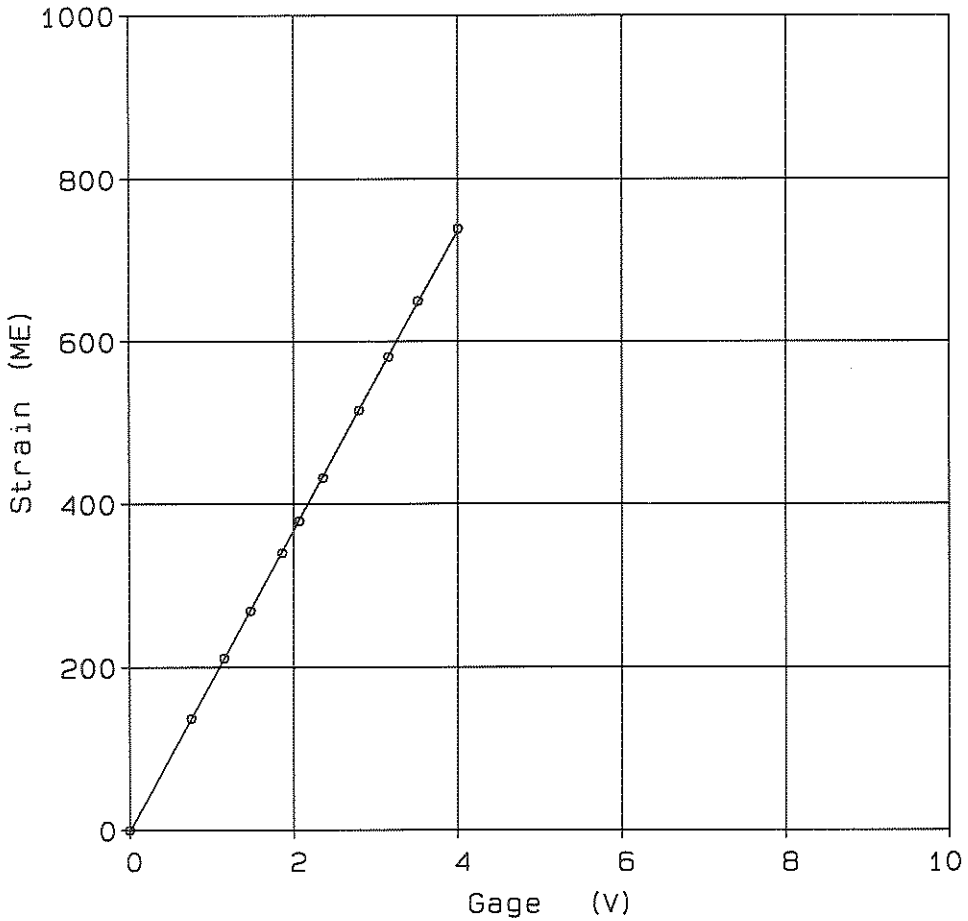

PDA Cal Factor = 184.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 642.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
137	.75
211	1.16
269	1.48
340	1.86
380	2.08
433	2.36
516	2.81
582	3.16
651	3.53
740	4.01

Calibrated by: J. Denkelhoff

Calibrated on: 18-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2