Pile Dynamics, Inc.

Transducer 390W

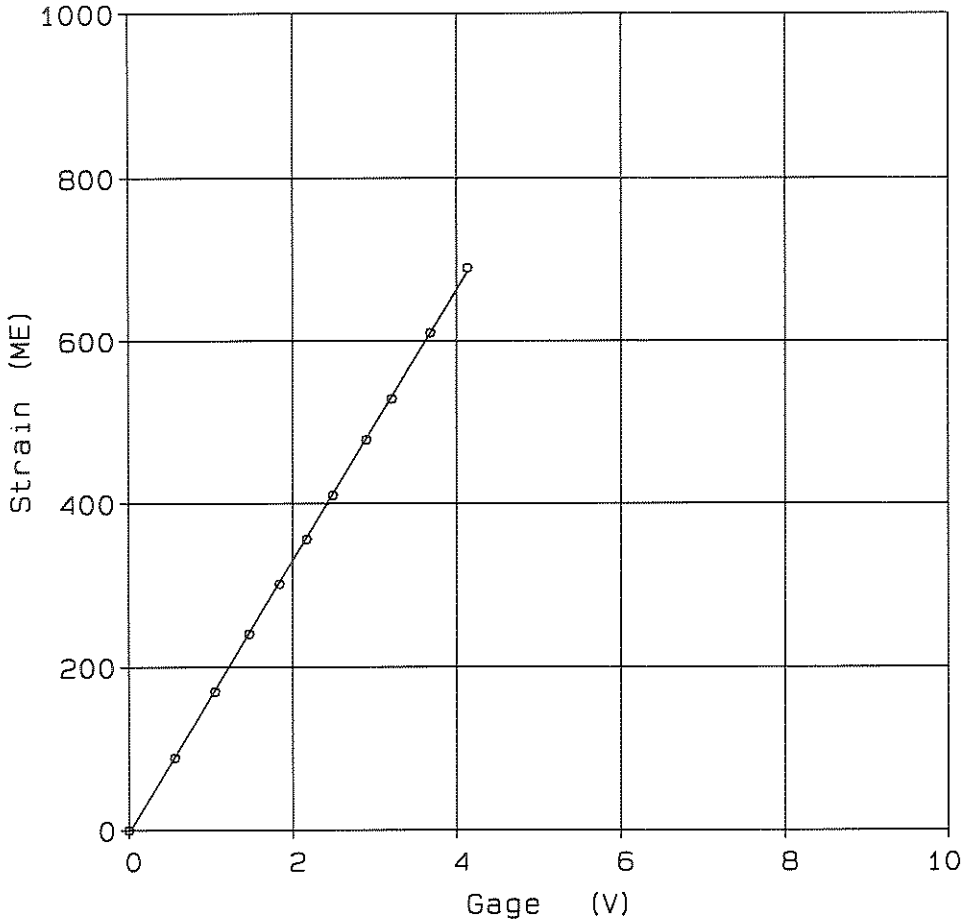

PDA Cal Factor = 166.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 578.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
90	.56
170	1.05
241	1.48
301	1.84
356	2.17
410	2.50
478	2.90
529	3.21
611	3.69
690	4.14

Calibrated by: _____

Calibrated on: 27-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2