Pile Dynamics, Inc.
Transducer 391W

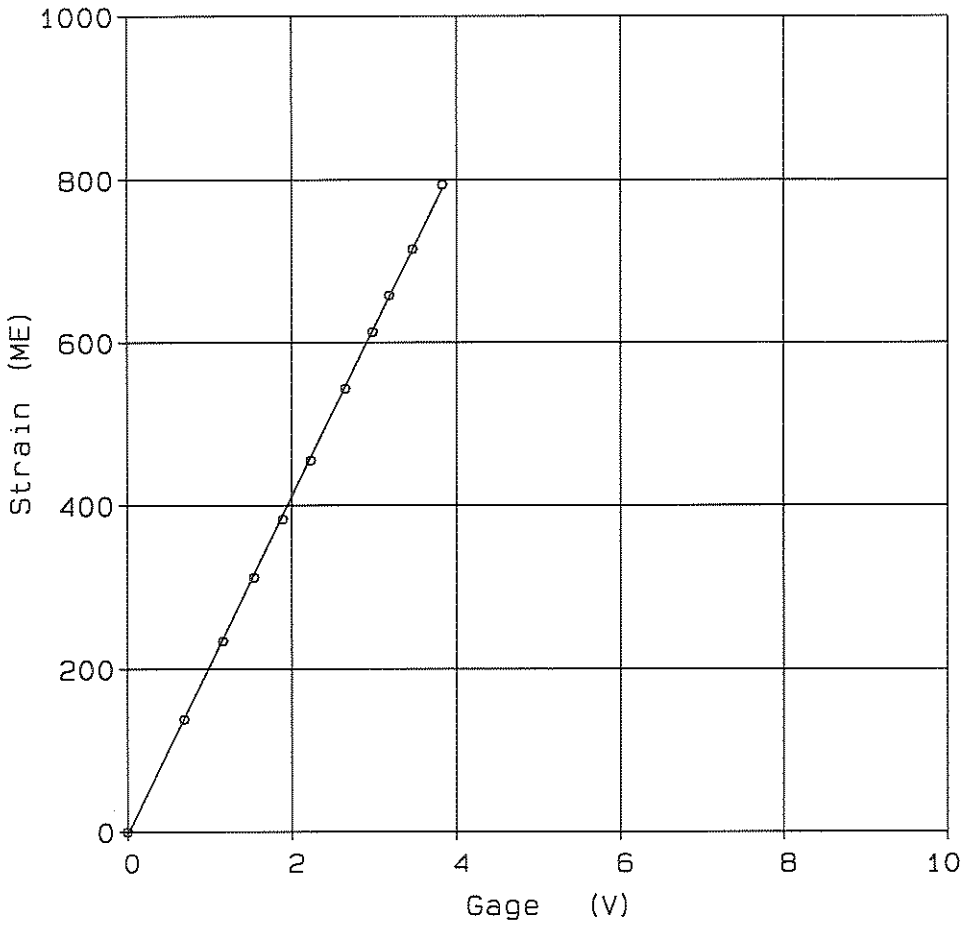

PDA Cal Factor = 207.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 721.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
138	.69
234	1.16
312	1.55
384	1.89
456	2.24
544	2.65
614	2.98
658	3.19
715	3.46
794	3.83

Calibrated by: J.S. Tarkenton

Calibrated on: 27-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2